




**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

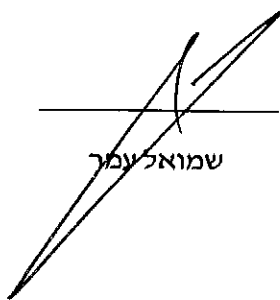
מס' ועדה: <u>161862</u>	יחידה מזמינה: <u>פגים</u>
מהות הרכישה: <u>מכשיר לשינוע אינקובטורים</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>₪ 25,400 (כולל מע"מ)</u> <u>(כולל גלגל)</u>	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: <u>לבנט</u>	


הוועדה התכנסה בתאריך 26.7.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

  
ר"ח שידוני זאב

  
שמואל עמר

  
עוי"ד רות פרי

  
יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

19 ביולי 2016

סימוכין: 07-07

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

שלום רב,

### הנדון: רכישת מכשיר לשינוע אינקובטורים למחלקת פגים

מדובר במערכת על גלגלים הכוללת מצבר פנימי נטען, אשר מתחברת לאינקובטור לצורך שינועו ממקום למקום. תבורי המערכת מאפשרים מתן גיבוי חשמלי לחימום האינקובטור עצמו וכן למכשור רפואי נלווה ותומך חיים כמו מכונת הנשמה, מוניטור ומשאבות מזרק.

מבדיקת הספרות המקצועית והתייעצות עם מומחים מתברר שהמכשיר מדגם GIRAFFE SHUTTLE, הנו היחיד היכול לשנע את האינקובטורים דגם GIRAFFE ( הנמצאים בשימוש הפגיה ) והכולל גיבוי חשמלי מקביל ומובטח של יותר מ – 40 דקות לחמום האינקובטור ולהפעלת מכונת הנשמה, מוניטור ומשאבת אינפוזיה. זהו בעצם מכשיר יעודי תואם ואביזר משלים ל 15 האינקובטורים של מחלקת פגים, במקרים של העברות פגים ( במיוחד בטיפול נמרץ ) ממקום למקום.

לאור נתונים אלו ממליץ לראות את המכשיר דגם GIRAFFE SHUTTLE תוצרת חבי GE DATEX-OHMEDA ( סוכן: לבנט בע"מ ) כציוד יחודי ואת חבי לבנט בע"מ, נציגו הבלעדי של היצרן בארץ, ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין  
מנהל מחלקת הנדסה רפואית  
וינטראוב