



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 172014

יחידה מזמינה: תהודה מגנטית

מהות הרכישה: תיקון מערכת MRI 1.5 TESLA-MAGNETOM AVANTO FIT

ערך בשקלים: _____


סכום הרכישה מטבע ספק: 39,240 יורו (כולל מע"מ)


ספק פוטנציאלי: סימנס הלתיקר בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 21.3.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

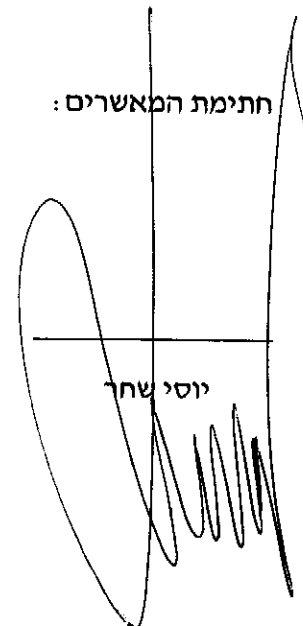
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רו"ח/שליבן זאב


שמואל עמר


עוי"ד רות פרי


יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

16 במרס 2017

סימוכין: 19-03

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: אשור תיקון שולחן בדיקה של MRI 1.5T דגם AVANTO FIT תוצרת חברת SIEMENS

שתן משקית שהיתה מחוברת לחולה משותק נשפכה על מיטת הבדיקה של מכשיר ה-MRI שבנדון.
כתוצאה מכך נגרם נזק חמור למערכת האלקטרונית של המיטה, אשר השבית כליל את כל מכשיר ה-MRI.
לאחר בדיקה של הספק והתייעצות עם היצרן בחו"ל התברר, שיש צורך להחליף את מספר חלקים עקריים
במיטת הבדיקה. לאור חשיבותה של המערכת והנחיצות להשמישה באופן מיידי – הוזמנו החלקים באופן
דחוף מחו"ל והמערכת חזרה לתפקוד מלא כבר לאחר 3 ימים ביום אי 12.3.17.
היות וחברת סימנס ישראל הנה הנציגה הבלעדית של היצרן בארץ ורק לה הידע והחלפים הדרושים לתיקון
המערכת – ממליץ לאשר את התיקון על פי הצעתה ולראות בה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

די"ר ולנטין
מנהל מחלקת הנדסה רפואית
וינטראוב