

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(כריאל בית שיבא)
יחידה מזמינה:	תינת זיקולוגי
תאריך:	4/10/19

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070082	מערכת דיאטרמיה מדגם D VIO300

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונ-ץ שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא


סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	511053/18
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,640 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

תיאור  
יוסמך אחר:



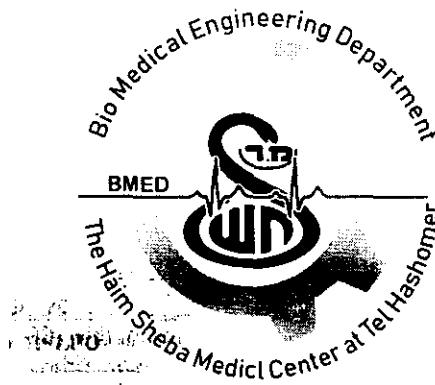

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1 באפריל 2019  
מספרנו: עש/0120-2019  
תיק: 4005, 1118

לכבוד  
גבי לירון פור-דניאלי  
כ.א.ן

**הנדון: ח.נ.גניקולוגי- חו"ד לרכישת מערכת Electrosurgery system**

במסגרת השלמה והחלפת פריטים במגדלים לפרוסקופיים, הנמצאים בשימוש במערך הגניקולוגי הכירורגי, עקב בלאי והתיישנות מכשור נדרשת רכישה המכשיר שבנדון בכמות של 1 יחידה. מדובר במכשיר המשמש לביצוע פעולות אנדוסקופיות וכירורגיות באמצעות אספקת זרם חשמלי בתדר גבוה בעל קוטביות משתנה, כאמצעי לפעולות חיתוך, הקרשה והסרת רקמות.

בקשת הצוות הקליני הינה לרכישת הדגם VIO300D מתוצרת ERBA מהנימוקים המקצועיים הבאים:

הדגם המבוקש מתוצרת ERBA הינו ייעודי לביצוע פעולות רזקציה בתחום ההיסטרוסקופיה ע"י חיבור למכשור קצה מתאים ואספקת האנרגיה החשמלית הביפולרית הנדרשת להפעלתו.

הדגם מאפשר חיבור למכשור היסטרוסקופיה המיוצר ע"י מגוון רחב של יצרנים, ביניהם למכשיר רזקטוסקופ מתוצרת STORZ הנמצא בשימוש במערך. מכשיר זה משמש לפעולות כירורגיות של חיתוך והקרשה שאינן מצריכות הרדמה, באמצעות אלקטרודות ביפולריות ייעודיות.

מכשיר ייחודי זה מאפשר חיבור לדיאטרמיה המבוקשת מתוצרת ERBA המשמשת לו מקור אנרגיה. למען הסר ספק, ללא הדיאטרמיה לא ניתן יהיה להפעיל את מכשור ההיסטרוסקופיה.

נתונים אלו נבדקו באמצעות התנסות בפועל במכשור חלופי מדגמים אחרים תוצרת MEDTRONIC ו-GYNECARE.

מצורפת הצעת מחיר 52978 של חברת ברסלויער לדגם VIO300D תוצרת ERBE. מומלץ לממש ההצעה המלואה.

מאחר ולא נמצא מערכת Electrosurgery העונה לנדרש ומאפשרת חיתוך והפעלה של מכשור היסטרוסקופיה הנמצא בשימוש במערך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישת מערכת זו. על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה בכמות 1 יחידה מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל על פי המפורט בהצעת המחיר. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

יש להעביר חוות דעת זו למחלקת הרכש לצורך מימוש בתוספת סעיף תקציבי.

בברכה,  
ענבר אמוני-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: ד"ר אורקין דינה  
ד"ר שדמי יורם  
גבי אשר אביבה  
מחיר רכש