

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הפק' (ויאל) ק"ח לטק"א	משרד:
מרכז מרכז	יחידה מזמינה:
14/05/19	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082673	VP8 BT18 INCL VOLUSON CARE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

אלדן	שם הספק:
510848690	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1148	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ	ספק זה הינו:
\$25,000 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24	תקופת ההתקשרות

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

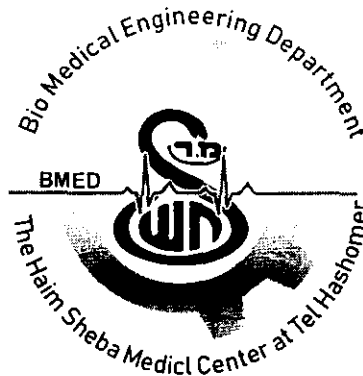

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 במאי 2019
מספרנו: יש/2019-0132
תיק: 3-1125, 0045

לכבוד
פרופ' בועז וייס
כ.א.1
נכבדי,

הנדון: מרכז מירב – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל פרופ' פרידמן מיום 25.3.19
דוא"ל פרופ' בועז וייס מיום 1.4.19, 27.8.19
דוא"ל דר' קורח מיום 27.3.19

במרכז מירב נדרש מכשיר אולטראסאונד באפליקציה גניקולוגית כדי לתת מענה במרפאת נשאות למטופלות שבסיכון לחלות בסרטן השתלות.

הדגם המצוי בשימוש הינו דגם LOGIQ C3 פרימיום משנת 2011 ולפיכך הטכנולוגיה שבו מיושנת בהשוואה לדגמי המכשור העכשוויים, מצב המאופיין במיוחד בשיעור הרזולוציה הנמוכה ובחוסר יכולת חדמיית FLOW דחיינו – דופלר.

הדגם העכשווי העונה לנדרש הינו דגם VOLUSON P8 BT18 המאפשר מתן חדמיה גניקולוגית ודופלר באיכות גבוהה אשר כולל את המרכיבים העיקריים הבאים:


- מכשיר הכולל מסך שטוח בגודל 17" מסוג LED ברזולוציה גבוהה 1280x1024 pixels יכולת מיקום בו-זמנית של 3 מתמרים מעי הפעלה מסוג WIN-10
- כונן מסוג DVD+R/CD-R בקיבולת 500GB מודי הפעלה כולל:
- ANATOMICAL M-MODE (2D) עבור MOTION ועבור
- דופלר מסוג PW (Pulse Wave),
- CFM
- PD
- HD FLOW
- Automatic Tissue Optimization
- Auto TCG
- דוושח+מדפסת ש/ל

חברה: BT-18 משמעותו תוכנת הפעלה WIN-10 + אבטחת מידע (Advanced Security Package)

מאפיינים של המכשיר הרלבנטיים למרכז מירב:

- טכנולוגיית CrossBeam (CRI) – יכולת שיפור רזולוציה באמצעות עיבוד טכנולוגי של כמות תמונות נוספות על אותם אובייקטים במנחים שונים המגדיל משמעותית את הרזולוציה.
- קומפקטיות, נוחות וקלות לשימוש ולניידות.
- כולל אבטחת מידע (Advanced Security Features)

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

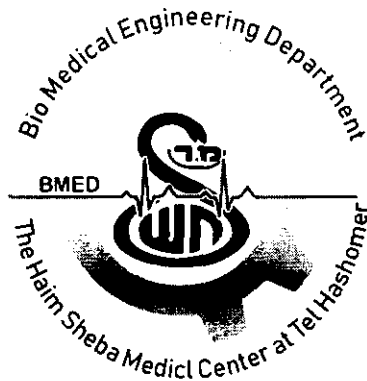

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

רצ"ב הצעת חב' אלדן הכוללת את החומרה והתוכנות כמפורט לעיל ובנוסף המתמרים הבאים :

- מתמר אבדומינלי (CONVEX) דגם 4C-RS בתחום תדרים 2-5MHz.

- מתמר וגינלי דגם IC9-RS בתחום תדרים 2.9-9.7MHz.

משתמשי המכשור כיום הינם אנשי גינקולוגיה כך שיש חשיבות עליונה לשימוש בדגם המוכר למשתמשים.

קיימת זהות עם המכשור הקיים בגניקולוגיה כמו גם במתמרים כך שתהיה יכולת גיבוי הדדי בעת הצורך.

יש לממש הצעת חב' אלדן על כל סעיפיה העונה לכל שנדרש בהתאם לבקשת פרופ' וייס.

בהתאם לנייל ניתן לראות את היצרן GE ספק בלעדי לרכישה, על מנת לשמור על אחידות המכשור בתחום ההדמיה העל-קולית בגניקולוגיה.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות בהתאם למקובל בביה"ח. בתקופת האחריות יבוצעו כל הטיפולים התקופתיים ע"י חב' אלדן כנדרש ע"י היצרן (טיפול שנתי).

ביום 7.5.19 ניתן אישור מע' מידע לדגם זה.

יש להעביר חוות הדעת למח' הרכש למימוש.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנחל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר

העתקים : פרופ' איתן פרידמן
ד"ר יורם שדמי
מח' רכש