



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 192561

יחידה מזמינה: רפואה גרעינית

מחות הרכישה: החלפת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE 68

סכום הרכישה מטבע ספק: 81,607 ₪ כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: ג'י אי מדיקל סיסטמס


1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 21604 ₪ כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 244821 ₪ באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 28.5.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים,


תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

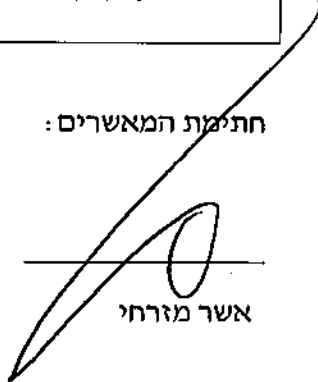
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


רו"ח שירן רינה


שמעאל עמר


עו"ד רועי אדרי


אשר מזרחי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

29 באפריל 2019
סימוכין: 25-04

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

אדונים נכבדים,

הנדון: החלפת (רכישת מקור קרינה מסוג (PIN SOURCE GE68) עבור מערכת PET/CT במכון רפואה גרעינית

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET/CT, דגם: DISCOVERY 690, מס"ד ביי"ח: 00756, יצרן: חבי. G.E., סוכן: G.E. HEALTHCARE, הכוללת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68. במערכת PET/CT יש צורך להחליף מקור קרינה עקב החלשות המקור מסוג PIN SOURCE GE68, שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפו כל 18 חודשים. בפעם האחרונה שהוחלף המקור במערכת היה בתאריך 26.12.17. המקור נדרש לכיול יומי, לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע. נכון להיום המקור חלש מאוד. כשהמקור חלש עלולות להופיע בעיות מגוונות ושונות בתפקודי המערכת ופגיעה באיכות התמונה ומקשה מאוד על עבודת המחלקה. על כן ממליץ לרכוש מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 חדש. היותו מקור קרינה זה הנו חלק חשוב למערכת, יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובחבי. G.E. ספק יחיד למקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 למקרה זה.

9002500049

מברכה,
שמיר ירון
ראש צוות דימות

