

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הפרימארי בי"ר שיבא)
יחידה מזמינה:	בי"ר נ"ו
תאריך:	16/06/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074365	SPARQ ULTRASOUND SYSTEM


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$244,846 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

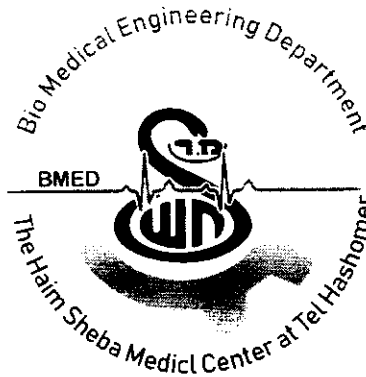

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 ביוני 2019
מספרנו: יש/0220-2019
תיק: 1125

לכבוד
ד"ר יובל לוי
כאן
נכבדי,

הנדון: בני"ח כללי/אגף פנימיות, כירורגיות ב' + ג' – חו"ד לרכישת אולטראסאונד לשימוש POC

- א. דוא"ל ד"ר גולדס מיום 22.7.18 ומיום 1.8.18
- ב. דוא"ל פרופ' שרעבי מיום 30.5.19
- ג. דוא"ל ד"ר יובל לוי מיום 19.5.19
- ד. דוא"ל רכש מיום 29.5.19

בחמשך לסימוכין ג' נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 7 יח'.

בסימוכין א'+ב' מבחירים ד"ר גולדס כנציג הכירורגיות ופרופ' שרעבי כנציג הפנימיות כי הדגם שנדרש הינו דגם SPARQ תוצרת חברת PHILIPS לטכח תוצאות בדיקות מכשור מקביל, במיוחד בדגש על איכות הדמיית האקו ובשל שמירה על אחידות המכשור המצוי בשימוש הן במיון והן בפנימיות, מצב בו הצוות הרפואי נגיש לדגם זה בתדירות גבוהה, עבר הדרכה ויאפשר גיבוי הדדי בעת הצורך – צורך חיוני שלא ניתן לפשרה.

הדרישות האופרטיביות מהמכשיר:

תוכנות:

Doppler Imaging, Critical Care

מתמרים:

לינארי בתחום תדרים 12-4MHz – לבדיקות כלי דם, הרדמות אזוריות, שלד, שרירים, איברים קטנים ושד
אבדומינלי בתחום תדרים 6-2MHz – לבדיקות חלל הבטן
SECTOR בתחום תדרים 4-2MHz – לאקו ברמת רזולוציה גבוהה שתאפשר יכולת צפייה בזרימות בלב כולל צבע Color Doppler

יש לממש הצעת המחיר הרצי"ב על כל סעיפיה.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

יש להעביר חוות הדעת למח' הרכש למימוש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' שרעבי
ד"ר י. קליינבאום
ד"ר י. שדמי
מח' רכש