

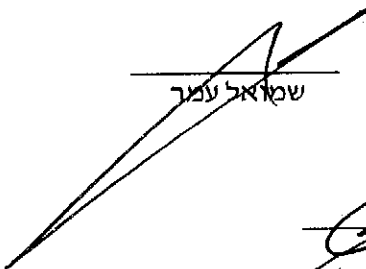






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה :	141342	יחידה מזמינה :	א/א
מהות הרכישה :	התאם - מתמר TEE MATRIX צגיו הנשי אולטראסונד (א' כס' 2E.37)		
סכום הרכישה מטבע ספק :	ערך בשקלים :	35139	החלטה
ספק פוטנציאלי :	רזנינג		

הוועדה התכנסה בתאריך 24.7.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :

 שמעאל עמר	 עוי"ד רות פרי	 יוסי שחר
 מיכל ארד	 שיר בן זאב	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

13 ביולי 2014

סימוכין: 05-07


לכבוד
וועדת הרכישות
כאן

שלום רב,

**הנדון: החלפת (רכישת) מתמר TEE MATRIX
עבור מכשיר אולטרא סאונד PHILIPS IE-33**

במחלקת אקו-לב מותקנת מערכת אולטראסאונד IE-33, מס"ד: 03843, יצרן PHILIPS
הכוללת מתמר תוך וושטי תלת מימדי X7-2T.
המערכת נמצאת בחוזה שרות עם חב' מדטכניקה.
ע"י אנשי שרות התברר שהמתמר X7-2T התקלקל עקב נזק שנגרם למתמר (יש סימני נשיכה
על הכבל ועל ראש המתמר מהחולה). במקרה של נזק אין כיסוי בחוזה שרות.
במקומו ממליץ לרכוש ולהחליף מתמר חדש.
היות והמתמר X7-2T הנו חלק אינטגרלי מהמערכת יש לראות ביצרן PHILIPS
ובחב' מדטכניקה ספק יחיד למתמר זה.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט

מהנדס מכשור רפואי
ראש מדור מכשור הדמיה

אנדריי וולקוב

מהנדס מכשור רפואי
בתחום אולטראסאונד

ע"פ ז"ק - 66872