




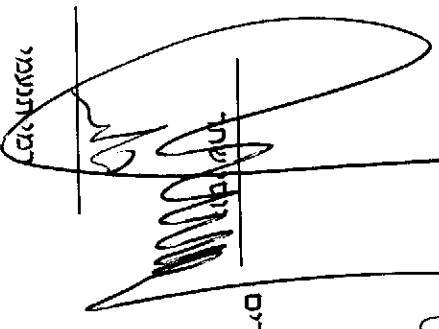

אישור פריסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה:	אלרופדיה
מס' ועדה:	101500-26
מחוז הרכישה:	ר"ג עקף טעי קנינה נאניה
סכום הרכישה מטבע ספק:	83,000 \$ עד בשקלים:
ספק פוטנציאלי:	מגנטיקה

חוזרה התכנסה מתאריך 10/5/16 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחר האוניברסיטה לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

 שמואל זיבר	 עידו רוטמן	 חגיבת המאשרים
	2016	מכלל ארמלי
		מכלל ארמלי

המרכז הרפואי תל-אביב
מתלקות הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

28 באפריל 2010

סימבובין : 24-04

לכבוד
וועדת רכישות
MNC
שלים רב,

**הנדון: רכישת גינת שקוף מגוי עם קליטה נמוכה
עבר מחלוקת אורטופדית**

1. לבית החולים נדרשת מערכת ניידת שקוף C-ARM MONI המתאימה בעיקר לניתוחי כף היד, כף רגל וקרוסול. הניידות הנה ייחודית בזה שהיא מפחיתה את החשיפה לקרינה לחולה ולרופא.
2. המערכת נדרשת לעמוד בפרמטרים הבאים:
א. זרם חצי נמוך. טווח זרם רחב יותר אשר נותן שיפור רזולוציה קונטורסט. רמות קרינה נמוכות יותר באפליקציות של כפות ידיים בעיקר.
ב. מוקד שפופרת רגסון הכי קטן. חדות גבוהה יותר ככל שגודל מוקד שפופרת הרגסון קטן יותר החממתה.
ג. רזולוציה של מגבר הדמות החזי גבוהה. ככל שעצמפות הקווים גבוהה יותר טווח כושר הפרדה טוב יותר. המשמעות איכות תמונה טובה יותר.
3. המערכת הניידת אשר על כל הפרמטרים הנ"ל הינה מערכת של רפ-מדטכניקה (יצרן : HOLOGIC)
4. בבדיקה שערכנו מצאנו מערכת נוספת של רפ ORTHOSCAN (סוכן : C.P.M), אך מערכת זו אינה ענה לקריטריונים המדרשים ואינה יכולה לספק את הבדיקות נחוצות ובאכזבת מחדשת.
5. אי לכך יש לראות בהפ מדטכניקה לספק יחיד במקרה זה.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט
מהנדס מתלמת הנדסה רפואית