

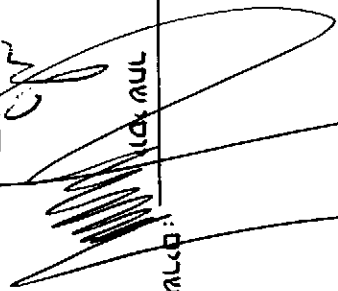




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מסוייגה :	ח.י.ג	נו.ח.י.נו.ג.ו.ג	מסיוועדה :	7-530-10
מחוז הרכישה :	4	מנא"ס + מתא"ס	ערך בשקלים :	
סכום הרכישה מטבע ספק :	₪ 174,000		ספק פוטנציאלי :	מ.צ יא.ק.ל.ס.ג

הוועדה התכנסה בלוארך 29.11.10 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחר האקסטרנט ללכלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

 שמואל עשכול	 עיד רוט פלג	 רונת שחר	חתימת המאשרים :
מנכ"ל ארזאלי		רמ"ת תנעמי	

27.04.2010

לכבוד:
ועדת מכרזים
סא

הנדון : רכישת 4 מנועים מהירות גבוהה – ת.ג. צירופוררביה

בהודעתנו יש צורך ברכישת 4 ססים מנועים לנתוחים נוירוכירורגיים עקב מספר הנתוחים שגודל והתדירות
המנועים הקיימים.

הפרמטרים הנדרשים לכל סס מנוע :

- מנת מופעל ע"י לחץ אוויר
- מודדת גבוהה של לפחות 90,000 ס"ד בלחץ של 120psi עם אפשרות וויסות המהירות בזמן שימוש
- חיבורים למעט :

- דורדלגד ב-3 מודות : קטן, בינוני וגדול
- ידומים ישדים ב-3 מודות : קצר, בינוני קטן, בינוני ארוך וארוך
- ידועין כפופים ב-4 מודות : קצר, בינוני קטן, בינוני ארוך וארוך

- המנועים יהיו מוגדרים כמנועים נוירוכירורגיים כולל נתוחים זרד האף
- לכל סס יהיה קופסת סטריליזציה

- ה-BURRS, DRILLS, CUTTERS, CRANIOTOME BURRS יהיו מוגדרים ע"י היצרן כ-REUSABLE וחובה לצרף לכל סס הוראות ניקוי ושימור
- ה-BURRS, במיוחד של קרניוסופיה ייבדקו בשטח כדי לבדוק מספר המחזורים שיכור
- לא תהיה התחייבות ברכישת כמות מינימלית של BURS או מתכלים אחרים
- תקופת האחריות של לפחות שנה

אתרי בריקת המכשירים הקיימים בשוק הישראלי, המכשיר החדש שמועד בדרישות, כולל מתכלים שלא מוגדרים
ע"י היצרן כפרויטים חד פעמים, זה המכשיר HILAN XS, יצרן AESCULAP, סוכן "צעל יעקובסון"
ממליץ לרכוש 4 ססים מנועים דגם HILAN XS, יצרן AESCULAP, המשרכה ייחודית מבודנת אפשרות עיכור
המתכלים מאושר ע"י היצרן ו"צעל יעקובסון" סוכן בלעדי של מנועים תוצרת AESCULAP

בכפרדה

דודרון לאקרה

ראשי מודת האקרה

ראשי מודת האקרה

מרכז המכרזים

מרכז המכרזים

מרכז המכרזים

מרכז המכרזים