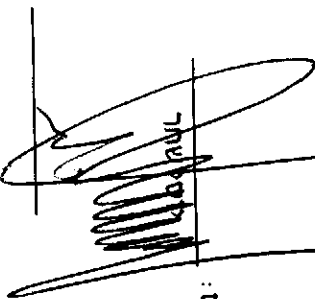


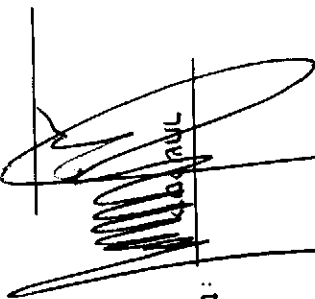




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ח.ג. אונקאולוגיה	מסי ועדה :	11565
מחות הרכישה :	מנטייר גינסטר - גיאטרימיה, לויג'אטי אונקופגיה, ליג'ים	עדד בשקלים :	
סכום הרכישה מטבע ספק :	\$ 33,213	ספק פוטנציאללי :	MTC

חוועדה התכנסה בתאריך 19.11 ואישורה לפרסם את חוות הדעת של תגורם
תמקצועי באחר האלקטרוני לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים : 
שמואל עמר  עו"ד דות פרי 
2211  דרמי תנעמי

מיכל אריאלי

תאריך: 26.04.2011
סימון: 21-04

לכבוד:
וועדת רכישת
כאן

הנדון: רכישת מכשיר כפולר-דיאטרמיה לנתוחי אורטופדיה ילדים

בת.ג., לצורך ביצוע ניתוחים חוזרים (כל מספר חודשים) אורטופדיים לילדים משתמשים בין היתר במכשיר דיאטרמיה. בניתוחים החוזרים של אורטופדיה ילדים מאוד חשובה פגיעה מינימלית, לכן יש צורך במכשיר שישטח העבודה שלו יהיה כמה שיותר קטן וגם שטח החימום כמה שיותר קטן כדי לא לפגוע ברקמות שמסביב לאזור הניתוח. המכשיר מוצרת ELLYUENCE, דגם SURGIMAX נתחן אפשרות לעבוד גם כמכשיר כפולר וגם כמכשיר מונופולר, דבר שמאפשר שימוש עם מכשיר אחד בזמן הניתוח. המכשיר הזה עובד במדרים הרבה יותר גבוהים ממדרים של מכשירי דיאטרמיה שבישומש בחדר ניתוח, דבר שגורם לחדידה הרבה יותר קטנה (0.02 מ"מ במקום כ-מ"מ אחד במקרה של דיאטרמיה רגילה). כמו כן חום בקצה של הכלים הרבה יותר נמוך ודיוק הרבה יותר גבוה, נמונים מאוד חשובים בניתוחים אורטופדיים חוזרים של אורטופדיה ילדים (reconstruction)
לאחר בדיקות שנערכו גם עם חברות וגם באינטרנט, המכשיר הנ"ל הינו בעל רמת מיקוד יחודית ובעל דיוק וחום ברמות מינימליות לפגיעה ברקמות אצל הילדים
אני ממליץ על רכישה מכשיר דיאטרמיה מדגם SURGIMAX, יצרן ELLYUENCE, סוכן MTC
MTC סוכן בלעדי של מכשיר זה בארץ והמכשיר מכשיר יחודי מבחינת הביצועים.

בברכה
דורון לאקה

מנהל מכשור רפואי

119
דורון לאקה
ראש מד"ר
חדר ניתוח ותשמה
מרכז רפואי מנכ"ל ע"ש
מרכז רפואי