



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה: מזכרה (המ/א/א/ג/י) מס' ועדה: 172070

מהות הרכישה: סגור מציג סביר - 2 ק, הנוכה וזלזל - זמ/ח/י


סכום הרכישה מטבע ספק: 132,210 \$ (מ"ל ל"ד) ערך בשקלים: _____

ספק פוטנציאלי: רני"מ

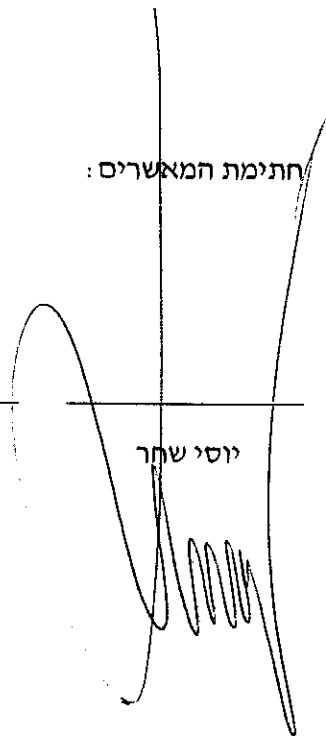
הוועדה התכנסה בתאריך 21.6.17 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רו"ח שלמה זלזל


שמואל עמר


עוי"ד רות פרי


יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

22 במאי 2017

סימוכין: 20-05

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

**הנדון: שדרוג מערכת ספירת דם, הכנה וצביעת משטחים עבור מעבדה
להמטולוגיה**

במעבדה להמטולוגיה קיימת מערכת ספירת הדם, הכנה וצביעת משטחים – תוצרת חברת Beckman Coulter הכוללת 5 אנלייזרים לספירת דם, שני מכשירים להכנה ומכשיר לצביעת משטחים. כדי לשפר את ההספק ואת דיוק האבחון, יש צורך לשדרג את המערכת על ידי החלפת שני אנלייזרים ומכשיר להכנת משטחים הישנים, בשני אנלייזרים ומכשיר להכנה וצביעת משטחים - כולם חדשים ומחוברים בתקשורת.

היות שמדובר בשדרוג מערכת קיימת, נדרש ציוד ייחודי, תוצרת אותה חברה כמו המכשירים הקיימים במעבדה, כדי להבטיח שיטת מדידה ועיבוד זהים בשימוש באותם ריאגנטים כמו של המכשירים הקיימים במעבדה, בגלל שהמכשירים משמשים לבדיקה ומעקב ממושך של אותם חולים, ויש צורך בקבלת תוצאות זהות ועקביות, וכדי שיהיה אפשר להשוות בין התוצאות השונות של אותם חולים במשך תקופת המעקב. מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שחברת רניום מדיקל בע"מ היא החברה היחידה שיכולה לבצע את השדרוג המפורט למעלה, על ידי הוספת שני אנלייזרים דגם UniCel DxH800 ומכשיר להכנה וצביעת משטחים דגם DxH SMS UniCel.

מדובר בציוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחב' רניום מדיקל בע"מ (הנציגה הרשמית של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה.

למכשירים אישורי אמ"ר המבוססים על אישורי FDA כנדרש.
מק"ט מכשיר UniCel DxH800 = 6018200515, מק"ט מכשיר UniCel SMS = 6018200678

בברכה,
לנה ויסמן
ראש צוות מעבדות רפואיות
מחלקת הנדסה רפואית