



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 172163

יחידה מוזמינה: רפואה גרעינית

מהות הרכישה: החלפת מקור קרינה מסוג 68 PIN SOURCE GE למערכת PET CT

ערך בשקלים: _____


סכום הרכישה מטבע ספק: 69,750 ש"ח(כולל מע"מ)

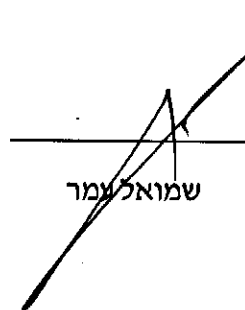
ספק פוטנציאלי: ג'י אי מדיקל סיסטמס בע"מ 210-100-3424


הוועדה התכנסה בתאריך 15.11.17 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם


המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רויכ שירן


שמואל צמר


יועץ משפטי


יוסי שחר

2 בנובמבר 2017
סימוכין 02-11

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

אדונים נכבדים,

הנידון: החלפת (רכישת) מקור קרינה מסוג (PIN SOURCE GE68) עבור מערכת PET/CT במכון לרפואה גרעינית

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET/CT דגם: DISCOVERY 690 , מס"ד: 00756,
יצרן: חברת GE. סוכן: G.E. HEALTHCARE הכוללת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68.
במערכת הנ"ל יש צורך להחליף מקור קרינה עקב הזלשות המקור מסוג PIN SOURCE GE68 ,
שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפו כל 18 חודשים.
בפעם האחרונה שהוחלף המקור במערכת היה בתאריך 16/4/16 .
המקור נידרש לכיול יומי, לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע .
נכון להיום המקור חלש מאוד ומקשה מאוד על עבודת המחלקה .
כשהמקור חלש עלולות להופיע בעיות מגוונות ושונות בתפקודי המערכת ופגיעה באיכות התמונה.
על כן ממליץ לרכוש מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 חדש. היות ומקור קרינה זה חלק חשוב
מהמערכת, יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת וחברת G.E. ספק יחיד למקור קרינה מסוג
PIN SOURCE GE68 למקרה זה.

בברכה

ד"ר ולנטין ווינטראוב
מנהל מח' הגרעין רפואית