



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 172202

יחידה מזמינה: צינתורים

מהות הרכישה: תיקון חדר צינתורים מס' 6 מדגם FDA10 תוצרת פיליפס


סכום הרכישה מטבע ספק: 113,810 דולר (כולל מע"מ)

ספק פוטנציאלי: מדטכניקה בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 26.12.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

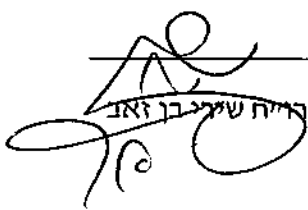

ד"ר שׁיחי בן זאב

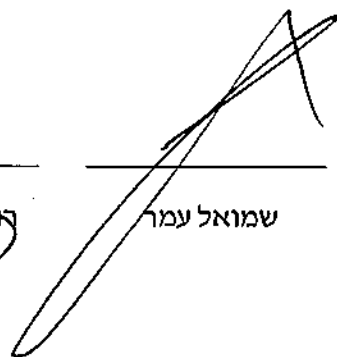

שמואל עמר



יועץ משפטי



יוסי שחך

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

10 בדצמבר 2017

סימוכין: 14-12

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: תקון חדר צנתורים מס' 6 עקב נזילת מים

ארון בקרה של מערכת צנתורים מדגם FDA10 תוצרת חב' PHILIPS (סוכן: מדטכניקה), נפגע כתוצאה מנזילת מים מצנרת המזגן בתקרה שמעליה. כתוצאה מהנזילה, ניזוקו מספר רכיבים אלקטרוניים אשר היה צורך להחליפם. לאחר התיקון, נבדקה המערכת והוחזרה לשימוש מלא. היות וחברת "מדטכניקה" היא הנציגה הבלעדית של יצרן המערכת בארץ (חב' PHILIPS) ורק לה בלבד יש את הרכיבים והידע הנדרשים לטיפול בתקלה – יש לראות בה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית