

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקרמל
יחידה מזמינה:	מכון אולטרא
תאריך:	8.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


תיאור פריט	מק"ט	מס'
SUPER HIGH BRIGHTNESS FHD SURGICAL MONITOR "27	1095082863	4
IMAGE 1 H3-Z SPIES THREE-CHIP FULL HD CAMERA HEAD	1095077657	3
IMAGE1 H3-LINK MODULE FOR USE WITH IMAGE 1 FULL HD	1095077640	2
IMAGE 1 CONNECT MODULE FOR USE WITH UP TO 3 LINK MODULES	1095077590	1
COLD LIGHT FONTAIN XENON 175 WITH INTEGRATED KARL STORZ SCB	1095067732	5
MONITOR HOLDING ARM HEIGHT ADJUSTABLE INCLINABLE MOUNTABLE O	1040016883	7
EQUIPMENT CART LC	1040011066	6

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דר' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

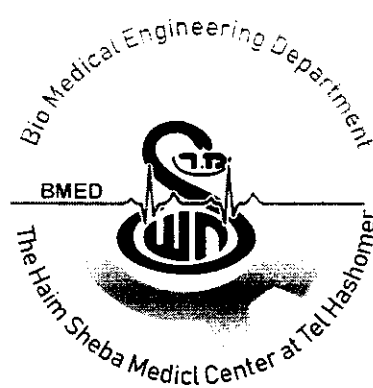

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 ביולי 2019
מספרנו: יש/2019-0256
תיק: 6-1130, 1006

ד ח ו פ

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: מכון אורולוגי – חו"ד לרכישת מע' אנדוסקופית לציטוסקופיה

דוא"ל פרופ' רמון מיום 1.5.19
דוא"ל פרופ' רמון מיום 23.5.19
דוא"ל חבי שניטל מיום 2.7.19

בעקבות סימוכין א'+ב' ולאחר בדיקה של כל מרכיבי המערכת האנדוסקופית לציטוסקופיה, נדרש להחליף מצלמה, ספק כח, מסך, מקור אור ועגלה על כל מרכיביה.

מדובר במערכת קיימת מיום 14.6.1999.

החלפת מצלמה בלבד לאחר שהמקורית כשלה לא הניבה תוצאות רצויות (בעיית תמונה במסך) ורק לאחר שהוצגה בפני פרופ' רמון מע' חלופית מושלמת ניתן אישורו לתקינותה בהתאמה לנדרש.

פנייה לחבי שניטל לקבלת מענה למערכת מתוצרת R. WOLF נענתה כי אין ליצרן אפשרות לתת מענה ולפיכך לא תגיש הצעתה (סימוכין ג').

לנוכח הצורך חדחוף במתן פתרון למכון האורולוגי רצ"ב הצעת חבי STORZ באמצעות חבי ברסלוער אותה יש לממש לאחר שאושרה כאמור ע"י פרופ' רמון.

לנוכח התייחסות חבי שניטל שבסימוכין ג' ניתן לראות את חבי STORZ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

לנוכח המסר של פרופ' רמון נא לטפל בהזמנה בלוח הזמנים הקצר ביותר שניתן.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' י. רמון
ד"ר י. שדמי