

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקניאור
יחידה מזמינה:	שקף נחמי
תאריך:	5.9.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080735	V60 VENTILATOR WITH C-FLEX AND AVAPS
3	1040013831	V60 STAND PARTIALLY ASSEMBLED
2	1040013823	ASSY BATTERY LI-ION 11AH V60


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____

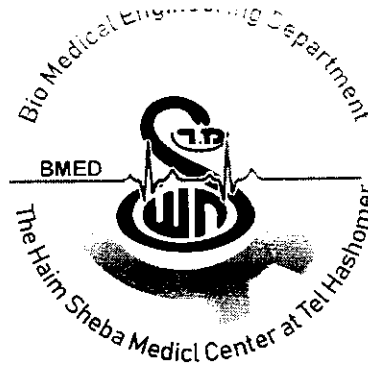

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 באוגוסט 2019
מספרנו: יש/2019-0264
תיק: 5012-1,1115F

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש
נכבדתי,

הנדון: שבץ מוחי – חו"ד לרכישת BIPAP

דוא"ל מיום 9.7.19

נדרשת רכישת כמות של 3 יח' שאושרה בסימוכין.

להלן הדרישות מהמכשיר:

א. מתן מענה להנשמה לא פולשנית לחולים בשיטות ההנשמה:
S/T, PCV, IPAP, EPAP, CPAP

ב. Max Flow לפחות 160LPM – יתרון לערך מירבי

ג. ניטור ריכוז חמצן (FiO2)

ד. קיום מערבול חמצן-אוויר

ה. קיום מדד של Inspiratory Time

ו. קיום מד של Respiratory Rate

ז. קיום תצוגה גרפית של לחץ, נפח, ספיקה (FLOW)

דרי' אוריון מנהל שבץ מוחי הבחיר כי שני הפרמטרים הבאים מהווים תנאי סף לרכישה:

א. קיום ניטור ריכוז חמצן FiO2

ב. קיום מערבול חמצן-אוויר

יתרון משמעותי יינתן לקיום תצוגה גרפית של לחץ, נפח, ספיקה (FLOW).


מבדיקת ארבעת דגמי המכשור הרלבנטיים עולים הממצאים הבאים:

א. לדגם VIVO 40 תוצרת BREAS המצוי בשימוש בביה"ח אין מנה לניטור ריכוז חמצן, אין קיום מערבול חמצן-אוויר ואין תצוגה גרפית של לחץ, נפח, ספיקה.

ב. לדגם VENT 40 תוצרת WELDMANN אין מענה לניטור ריכוז חמצן אין קיום מערבול חמצן-אוויר.

ג. לדגם V60 תוצרת PHILIPS/RESPIRONICS קיים מענה לשני הפרמטרים החיוניים וגם לתצוגה גרפית.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHEME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

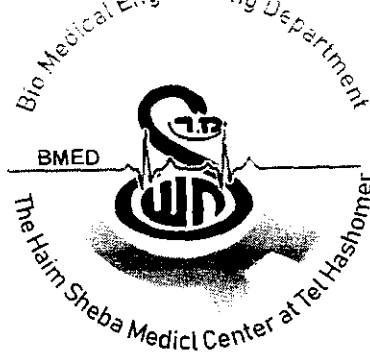

משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ד. לדגם STELLAR 150 תוצרת RESMED אין מענה למערבל חמצן-אוויר.

סיכום

מומלץ לממש רכישת דגם V60 בהיותו הדגם היחיד שלו מענה לנדרש ע"י דר' אוריון.
ניתן לראות היצרן ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים הכוללת טיפולים תקופתיים כנדרש וכמתחייב.
תינתן ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דר' דוד אוריון
דר' יורם שדמי
גבי מרינה ליפשיץ
גבי אורנה רחמינוב
גבי אינה אוסטרוביץ