

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבניין
יחידה מזמינה:	ח.נ. כיורולגיה סלסל
תאריך:	5.9.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
8	1095082111	DERMATOM MODEL S6 HANDPIECE ONLY
9	1040017154	DERMATOME STERILIZATION TRAY
7	1040015729	IN CLIP PADGETT MODEL S66
6	1040015711	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S65
5	1040015703	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S64
4	1040015695	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S63
3	1040015687	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S62
2	1040015679	IN CLIP FOR MODEL S61
1	1040015661	HEAD ASSEMBLY GUARD PLATE


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דר' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

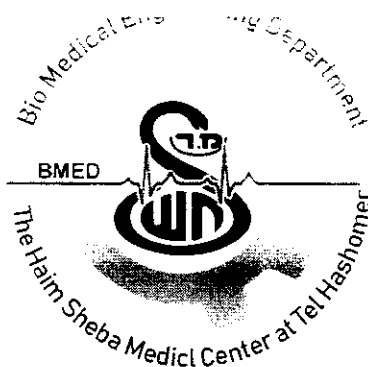

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14 באוגוסט 2019
מספרט: יש/2019-0326
תיק: 1001, 1147

לכבוד
גבי לירון דניאלי-פור
כאן

נכבדתי,

הנדון: חדר ניתוח לכירורגיה פלסטית – חו"ד לרכישת מכשיר דרמטום (DERMATOME)

דוא"ל מיום 13.8.19

בחדר ניתוח לכירורגיה פלסטית מצויים מכשירי דרמטום מתוצרת INTEGRA PADGETT.

בעקבות הודעת היצרן כי מכשיר תקול מדגם B שאינו ניתן לתיקון (יושבת), הוחלט ע"י פרופ' חייק ודרי אורקין כי הדגם החלופי שנדרש הינו דגם S6.

לדגם S6 יתרון משמעותי בכך שהוא מאפשר גמישות רבה יותר בבחירת גודל מקטעי העור (גראפטים) שיילקחו מהמטופל. הדגם S6 מאפשר לקחת גראפטים ברוחב של עד 6 אינץ' לעומת דגם B. לתכונה זו חשיבות מיוחדת במקרי כוויות נרחבות בהם נדרש לקחת גראפטים גדולים המורכבים מכמה שפחות מקטעים, זאת על מנת לחקטין את מידת הסיכון ואי-הנוחות למטופל. דרישה מקצועית זו נמצאה מקובלת וקבילה.

לאור הנייל יש לממש הצעת מחיר מס' OF19000722 לרכישת הדגם S6 בכמות 1 יח' במסגרת עסקת טרייד-אין עם דגם B שניזוק ולא ניתן לתיקון לאחר בדיקת היצרן. יש לממש החצעה במלואה.

קיימת חשיבות עליונה לשמירה על אחידות המכשור. לפיכך ניתן לראות ביצרן ובנציגותו ספק בלעדי לרכישה זו.

על החזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם לחוראות היצרן.

יש להעביר חו"ד זו לרכש לצורך מימוש.

בברכה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' יוסף חייק
דרי דינה אורקין
דרי יורם שדמי
מח' רכש