

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(קרנאל)
יחידה מזמינה:	ג.י. פז
תאריך:	24.10.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1098976269	VIDEO LARYNGOSCOPE MILLER N.1 SINGLE USE
3	1098976251	VIDEO LARYNGOSCOPE MILLER N.0 SINGLE USE
2	1095083465	C-MAC S PEDIATRIC IMAGER SET WITH C-MAC SYSTEM INTERFACE
1	1095076626	מערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	511053118

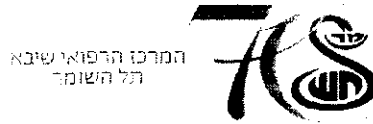

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387


31 בינואר 2019
מספרנו: מב/0025-2019
תיק: 4503, 1130-6

לכבוד
ד"ר רם מזכרת
1א

הנדון: מח' ט.נ. פגים – חו"ד לרכישת מערכת וידאו-לרינגוסקופ.

- א. תכתובת חב' בפקס מיום 14.01.18
 - ב. זוא"ל דרי מזכרת מיום 6.11.18
1. נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.
2. מדובר במערכת לביצוע אינטובציות קשות בפגים ויילודים הכוללת את המרכיבים הבאים:
- מוניטור צבעוני בעל שתי כניסות למצלמה.
 - מצלמה לצילום וידאו ותמונות סטילס כולל אפשרות לצפייה חוזרת.
 - יציאת USB לשמירה ואחסון המידע.
 - סיב אופטי + להבי לרינגוסקופ גמישים חד-פעמיים.
 - מעמד נייד לכל מרכיבי המערכת.
3. נבחנו שלוש האופציות הבאות ע"י המשתמש:
- א. דגם CMAC מתוצרת STORZ המשווק ע"י חברת "ברסלויער".
 - ב. דגם PeakVN מתוצרת PEAKE MEDICAL המשווק ע"י חברת "פיאק מדיקל טרייד".
 - ג. דגם InfantView מתוצרת ACUTRONIC המשווק ע"י חברת "בפקס".
- הבחרה: לא נמצאו ספקים מקומיים נוספים העונים לנדרש.
4. תוצאות הבדיקה הבהירו הממצאים הבאים:
- א. הדגם מתוצרת ACUTRONIC נפסל לרכישה על הסף עקב חוסר יכולת הדגמת המכשיר בפועל על מנת לוודא התאמתו לנדרש. לציין כי חברת "בפקס", נציגת היצרן ACUTRONIC חזרה בה מהצעתה בסימוכין א'.
 - ב. הדגם מתוצרת PEAKE MEDICAL נפסל לרכישה לאחר שנבדק במח' ט.נ. פגים ונמצא כי איננו עונה לנדרש, וזאת בהתאם לממצאי בדיקת הצוות הרפואי המפורטים בסימוכין בי-סעיף 1. למען הסר ספק, לדגם להבים גמישים שאינם מותאמים לעבודת המחלקה, שדה הראיה המתקבל באמצעותו הינו מצומצם ומסך הצפייה קטן.
 - ג. הדגם המוצע מתוצרת STORZ נבדק בפועל במחלקת ט.נ. פגים ונמצא מתאים לכל הנדרש.
5. סיכום
- יש לראות ביצרן STORZ באמצעות נציגתו המקומית חברת "ברסלויער" ספק יחיד לרכישה ולממשה בהתאם להצעת מחיר מס' 52564 במלואה.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה לכל מרכיבי המערכת המוצעת.

אסף
אסף

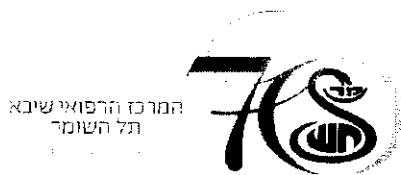

המרכז הרפואי שיבא
תל השומר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

6. יש להעביר חוות דעת זו למחלקת הרכש לצורך מימוש בליווי סעיף תקציבי.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' צפורה שטראוס
דר' יורם שדמי