

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(דח"א) אג' ק"מ (ש"פ)
יחידה מזמינה:	מ"ח (ניחוי) א' ב'
תאריך:	16/10/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095064341	HEATER UNIT FOR ECMO


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גאמידה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511383374
מספר ספק בשיבא	1768
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,000 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

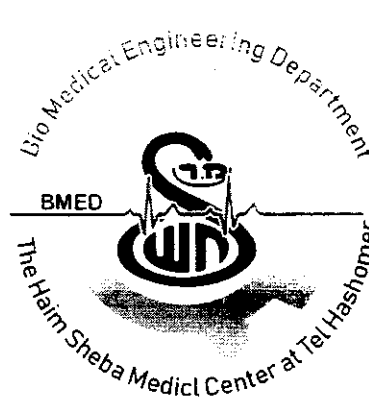

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 בספטמבר 2019
מספרנו: עעש/2019-0371
תיק: 1015, 1111-15

לכבוד
גב' גאולה נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: מחלקת ניתוחי לב – חו"ד לרכישת מחמם דם למערכת ECMO
מז/11999160 לרכישת מערכת ECMO

- בהמשך לסימוכין, נדרשת השלמת מערכת ה- ECMO על ידי רכישת מחמם דם מותאם.
 - המכשיר מיועד לפיזור חום לזרם הדם דרך ממברנה לשמירת חום גוף מטופל בטווח של 33-39°C. המכשיר צריך להתאים למערכת ה- ECMO בדגש על מידותיו והתאמה לכל עגלה אשר תירכש בהתאם לתוצאות המכרז. מדובר במערכת הכוללת מספר מרכיבים וצריכה לאפשר גם ניידות במידת הצורך.
 - נבדקו הדגמים הבאים:
 - דגם 550 תוצרת HICO
 - דגם HU-35 תוצרת MAQUET
 - דגם HU-35 נמצא מתאים למערכות ה- ECMO המוצעות במכרז ונמצא בשימוש בבית החולים. לעומת זאת, מאחר ולא סופקה אפשרות להדגמת דגם 550 תוצרת HICO, אין אפשרות לוודא התאמה למערכת ה- ECMO העתידה להירכש.
 - נומלץ לממש הצעת מחיר OXY 036/19 של חברת גאמידה לרכישת דגם HU-35 תוצרת MAQUET בכמות של 2 יח'. ניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בהתאם לאמור בסעיף 4.
- יש לממש הרכישה בדחיפות מאחר ומדובר בחלק בלתי נפרד מרכש מערכות ה- ECMO ולא ניתן להפעיל את מכשירי ה- ECMO ללא מערכת שלמה הכוללת מחמם.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה במקובל.
- תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

ב ב ר כ ה,

ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר סטרניק לאוניד
ד"ר כסיף יגאל
ד"ר ישדמי יורם
מר שוורץ ירון