

לכבוד

באמצעות דוא"ל-


שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 10/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת ההדחה לכלי סועד במרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

א. הבהרות מטעם המרכז הרפואי :

1. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לרכוש מערכת נוספת, בהתאם למפרט, מסמך ב' למסמכי המכרז, במהלך תקופת ההתקשרות, כאשר השוני מהמפרט הינו כיוון התנועה של המסוע, שיהיה נגד כיוון השעון ומיקום המדיח על גבי המסוע – ראו תכנית. הצעת המחיר של המציע במכרז תהא רלוונטית גם לגבי המערכת הנוספת, ככל ותירכש.

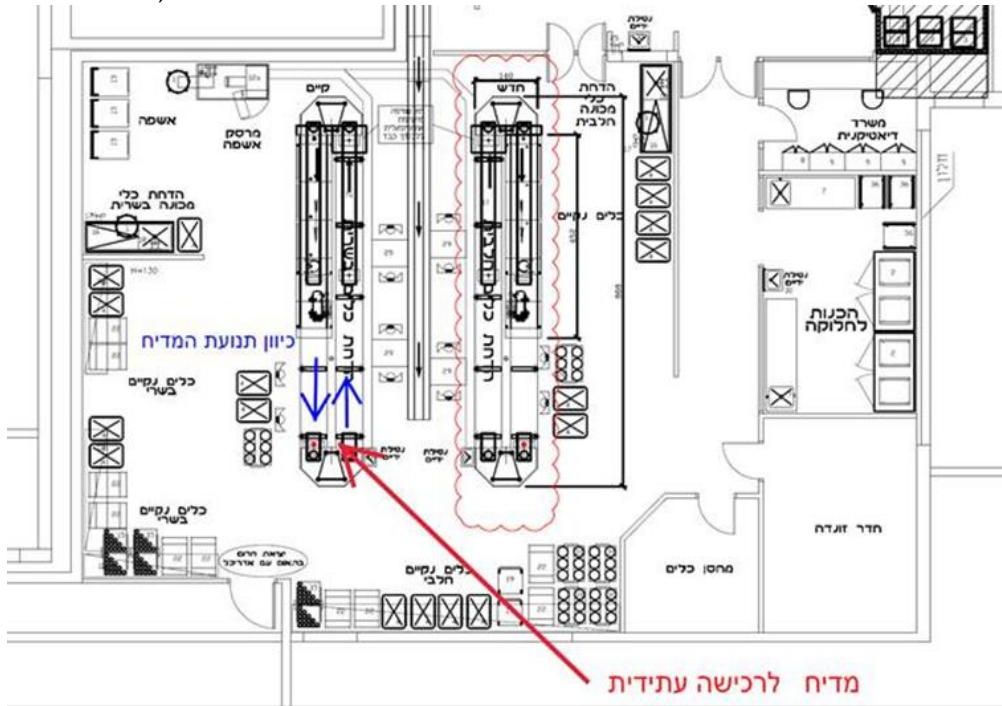

מדיח לרכישה עתידית



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | פקס 04-6344776 | טל. 04-7744202

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

2. המערכת שתוגש בגינה הצעה במכרז זה, תכלול מנגנון פיקוד המאפשר הפעלת המדיח בשבתות וחגים בהתאם לאישור מכוני ההלכה. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן, השינוי המבוקש, מופיע בסעיף 7א' להצעת המחיר.
יובהר כי על המציעים להגיש הצעתם רק עם טופס הצעת המחיר המעודכן.

ב. מענה על שאלות הבהרה:

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.			אבקש לקבל כחלק מפרוטוקול סיור הקבלנים את שמות הקבלנים שהשתתפו בסיור.	הבקשה אינה מתקבלת.
2.			נבקש לקבל תוכניות של חדר ההדחה בפורמט DWG . הנ"ל נדרש על מנת להכין תכנית העמדה שהינה חלק מדרישות ההגשה.	מצ"ב הקבצים בפורמט DWG
3.			נבקש דחיית הגשת ההצעה למועד מאוחר יותר על מנת שנוכל להגיש הצעה מלאה הכוללת תכנית העמדה. כמו כן, נבקש הארכה שלב הגשת השאלות מאחר ועולות שאלות בנושאים טכניים שונים במהלך הכנת התוכנית ע"י הספק.	הבקשה אינה מתקבלת.
4.	מסמך ב'	תפוקה מינימלית עמ' 18	240 תפוקה מינימאלית של 240 סל/שעה במהירות מסוע העומדת בתקן DIN10534 (מגע מינימאלית של הכלים עם המים למשך 2 דקות)- מבוקש להוריד את התפוקה המינימאלית.	נדרשת תפוקה של מינימום 240 סל שעה לפי DIN וחשיפת הכלים למים במשך 2 דקות - הבקשה להורדת התפוקה נדחית
5.	מסמך ב'	תפוקה מינימלית עמ' 18	מבוקש לשנות לתפוקה מקסימלית של 380 סל/שעה.	הדרישה מקובלת
6.	מסמך ב'	פעולת המדיח עמ' 18	מבוקש שטיפת כלים ראשונית (מוקדמת) במים קרים בטמפרטורת של עד 40°C	הטמפרטורות נדרשות להיות בהתאם לנדרש במכרז
7.	מסמך ב'	פעולת המדיח עמ' 18	מבוקש מספר שטיפות עם דטרגנטים בטמפרטורה בין 60-75°C	הטמפרטורות נדרשות להיות בהתאם לנדרש במכרז
8.	מסמך ב'	פעולת המדיח עמ' 18	מבוקש מערכת תכלות שטיפה סופית חסכונית eco-rinse בטמפרטורה שבין 85-90°C	הטמפרטורות נדרשות להיות בהתאם לנדרש במכרז
9.	מסמך ב'	פעולת המדיח עמ' 18	תיתכן לחות מינימלית של כמה טיפות שיתייבשו במהלך הפריקה ואחסנה. שימוש בחומר משטח טיפות rinsing aid	הדרישה לייבוש מלא לא משתנה



	תשפר את רמת הייבוש משמעותית. קרובה ל-0 טיפות				
10.	מסמך ב'	2.3.2	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	נא לבחור אופציה של איכות מים במציאות.	בית החולים שומר לעצמו את האפשרות לבחור באחת משתי החלופות, לכן הספק ייערך התאמת המערכת בעבודה לכל אחת מהחלופות.
11.	מסמך ב'	2.3.7	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	אין שליטה של לוח פיקוד מכונה לכמות דטרגנטים, ניתן לדרוש מספק הדטרגנטים משאבת סבון אוטומטית הפועלת על בדיקת מליחות המים	יובהר ההצעה כוללת אספקת משאבת דטרגנטים. ההבהרה לגבי אי שליטה של בקרת המדיח על כמות הדטרגנטים מקובלת.
12.	מסמך ב'	2.3.8	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	מבוקש התקן פינני האשפה משטיפה מוקדמת ללא עצירת המכונה	יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז
13.	מסמך ב'	2.3.9	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	בכניסת מים למכונה יותקן וסת לחץ לקביעת לחץ שטיפה סופית קבוע	ההבהרה מקובלת
14.	מסמך ב'	2.3.13	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	מצופי גובה מים במכונה ניתנים להחלפה רק בעצירת מכונה וריקון מים מהתא שבו מצוף לא תקין	ההבהרה מקובלת
15.	מסמך ב'	2.3.14	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	מבוקש כי כל מנועי המשאבות במדיחי כלים מוגנים IP44	יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז
16.	מסמך ב'	2.3.16	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 19	הדרישה מאריכה את הזמן הריקון. הצעתנו לרוקן כל תא בנפרד לתוך תעלות ריצפה קיימות	הדרישה לריקון דרך נקודה אחת לא מחייבת בכפוף לעובדה שהניקוזים ינוקזו לתעלות הקיימות בשטח.
17.	מסמך ב'	2.3.19.1	מבנה המדיח ותכונותיו עמ' 20	לפי כמות סלים מינימלית (סעיף 2.4.1) אורך מכונה 922 ס"מ	מאושר שינוי אורך המסוע בתנאי שהמערכת תתאים בממדיה למקום שהוקצע.
18.	מסמך ב'	2.4.2	מסוע המדיח עמ' 20	נבקש לאשר הגשת מסוע קרוסלה המבוסס על הנעה באמצעות רצועות (בדומה למסוע המגשים הקיים בבית החולים).	מאושר מסוע המבוסס על הנעה באמצעות רצועות, במידה ושיטת ההנעה תהיה בשיטה הנ"ל יש לבצע את ההנעה באמצעות מינימום 4 רצועות
19.	מסמך ב'	2.4.3	מסוע המדיח עמ' 20	מבוקש לאשר מרווח אופטימאלי 4 ס"מ	מאושר מרווח 4 ס"מ.
20.	מסמך ב'	2.4.6	מסוע המדיח עמ' 20	הנל אינו נדרש מאחר ובכל רגע נתון ניתן לשלוף את הסל ולחלץ עצמים שנתקעו וכמו כן מסוע בשיטת חוליות/גלילים הינו חד כיווני, נבקש לבטל דרישה זו (תנועה דו-כיוונית).	במידה ולא מוצע אפשרות להנעה דו כיוונית יש לצרף מפרט/ הסבר מפורט כיצד ניתן לטפל במקרים בהם המסוע ניתקע, וועדת מכרזים תבדוק ותשקול אישור מענה זה
21.	מסמך ב'	2.4.7	מסוע המדיח עמ' 20	בסעיף 2.4.7 נדרשים 3 מפסקי הפעלה/הפסקה למסוע, נבקש לאשר התקנת מפסקי חירום	הדרישה היא להפעלה והפסקה של המסוע בלבד במידת הצורך, לכן דרישה זו לא מאושרת



	בלבד כמופיע בסעיף 2.3.18 מאחר והפעלת/הפסקת המסוע מתבצעת במקביל להפסקת/הפעלת המדיח ולכן אין צורך בכפל מפסקים.				
22.	מסמך ב'	2.5.1	נידוף עמ' 20	יובהר כי סעיף 2.5.1 המתייחס למדיח עם מערכת לנטרול האדים ללא צורך במנדפים – הנ"ל תלוי באוורור החדר וכמות החלפות האוויר שבו.	הבהרה זו לא מאושרת, נדרש לנטרל את האדים, באופן מלא
23.	מסמך ב'	2.5.1	נידוף עמ' 20	נדרש מנדף להוצאת אוויר לח בטמפרטורה נמוכה כ-40°C	נדרשת מערכת לנטרול מלא של האדים כמופיע במכרז.
24.	מסמך ב'	2.7.1	אנרגיה עמ' 20	בשטח ישנם הכנות לתשתיות קיטור, האם חימום מים ע"י חשמל ולא תהיה אספת קיטור?	המערכת תופעל על ידי חשמל כמופיע במפרט
25.	מסמך ב'	2.8.1	פיקוד ובקרה עמ' 21	מבוקש IP67 – מיועד לטבילה במים לעומק מטר. IP65 – הגנה מפני התזת מים מכל הכיוונים בלחץ 30kPa	יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז
26.	מסמך ב'	2.8.2.1	פיקוד ובקרה עמ' 21	תקלות במערכת ההדחה- האם ניתן לתצוגה ואגירה	יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז.
27.	מסמך ב'	2.8.2.2	פיקוד ובקרה עמ' 21	צריכת ואיבוד מים- האם ניתן לאגר נתון עם תוספת מד מים	יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז.
28.	מסמך ב'	2.8.2.3	פיקוד ובקרה עמ' 21	צריכת דטרגנטים- לגבי ספק משנה – לא ניתן לאגר נתונים בשימוש משאבות סבון סטנדרטיות. אם ספק סבון יכול לאסוף נתונים ולספק אותם למדיח תבדק אפשרות לאיסוף ואגירה	השאלה אינה מובנת, יש להיצמד לדרישות המפרט הטכני במכרז.
29.	מסמך ב'	2.8.2.4	פיקוד ובקרה עמ' 21	צריכת חשמל- ניתן לאגר עם תוספת מד חשמל	נדרש לאגור.
30.	מסמך ב'	2.8.2.5	פיקוד ובקרה עמ' 21	רמת זיקוק של המים- רמת מליחות מים – תבדק אפשרות אגירת נתון במקרה שהספק סבון תספק את הנתון ללוח פיקוד של מכונה	הנ"ל נדרש
31.	מסמך ב'	2.8.2.5	פיקוד ובקרה עמ' 21	סעיף 2.8.2.5 – נדרש איסוף נתונים על "רמת זיקוק המים". הנ"ל באחריות מערכת הטיפול במים ואינו קשור למדיח, נבקש לבטל סעיף זה.	הכוונה היא היכולת לקבל מידע באמצעות מערכת הבקרה של המדיח ולא דווקא לשלוט על רמת זיקוק המים - סעיף זה לא מבוטל
32.	מסמך ב'	2.8.2.6	פיקוד ובקרה עמ' 21	נא להגדיר כל נתון	נתונים נדרשים : צריכת חשמל, צריכת מים צריכת דטרגנטים טמפרטורות המים בכל אחד



מהתאים התראה על תקלות					
מאושר פאנל פריק ודלתות בדפנות כפולות בעובי מינימאלי של 1.5 בלבד	מבקשים לאשר גוף ומבנה לא פחות מ-1.5 מ"מ. כיסויים ודלתות יהיו עשויים מ-304 בעובי לא פחות מ-1.0 מ"מ	מדף סלים משופע עמ' 22	2.10.4	מסמך ב'	33.
לוח הפיקוד יהיה על המדיח.	שטח מתוכנן להתקנת מדיח כלים עם לוח פיקוד על הקיר			שאלה כללית	34.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
 חתימה וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
 אפרת קולטון זלמה
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:
 דר' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
 גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן.
 עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן.
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
 מר גרשון קיגל-מנהל מערך המזון.
 מר אורי ליף-חברת סיסתמה- יועץ מקצועי למכרז זה.
 הרב דובב בנדיגר- רב המכרז הרפואי, כאן.
 תיק.



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

מסמך ג'

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי הלל יפה
ת.ד. 169, חדרה

א.ג.נ.,

הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז פומבי 10/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת ההדחה לכלי סועד במרכז הרפואי הלל יפה

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת דוגמת ההסכם, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
2. אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות ולמסמכי מכרז זה.
3. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית, הכלים המתאימים ועובדים מקצועיים לאספקת המערכת, התקנתה ותחזוקתה בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.
4. הננו מצהירים כי למדנו והבנו על בוריו את הדרישות ויתר מסמכי המכרז כלשונם. אנו מצהירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.
5. אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז, משך כל תקופת ההתקשרות.
6. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
7. אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור במכרז זה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

8. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
9. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבנכם.
10. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה מכם או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לדוגמת ההסכם שצורפה למכרז זה ומסכימים שכל המסמכים המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות ואישורים כפי שידרשו.
11. אנו מתחייבים כי העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 4 חודשים (ארבעה חודשים קלנדאריים) ממועד החתימה על ההסכם המצורף למסמכי המכרז.
12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
13. אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.
14. ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.
15. נציג מוסמך מטעמו ראה, ביקר ובדק את אתר המזמין בו תתבצע העבודה והוא יכול ומסוגל לספק את המערכת ולבצע את העבודות כנדרש לפי מכרז זה ונספחיו. כמו כן מצהירים כי המערכת והעבודות הנדרשות במכרז זה, בהירים לנו ואנו מתחייבים לבצעם במירב הקפדנות והיעילות במימונות וביעילות ובמקצועיות לשביעות רצון המזמין.
16. כי העובדים מטעמנו יהיו בעלי רישיונות וידע כנדרש לאספקת המערכת וביצוע העבודות כמפורט במכרז זה ובמסמכים המצורפים.
17. **מסמכים ואסמכתאות**
- ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעתנו על ידי ועדת המכרזים וכי בכל מקרה לשינויים כלשהם לא יהיה כל תוקף.
- ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים והן הסף, הנה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.
18. **טופס הצעת מחיר**
- א. לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין, אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז.



ב. ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המידה, התשקיף והמסמכים שצורפו להצעתנו זו.

ג. ידוע לנו, כי למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב- 20% מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

ד. על המציע למלא את כל המחירים בטבלה זו:

מס'	תיאור הפריט	כמות	יחידת מידה	מחיר ליחידה בש"ח	סה"כ לפריט בש"ח (מחיר ליחידה X כמות)
1.	מדיח סלים (מוביל פנימי) עם מסוע "קרוסלה" משולש כולל מערכת VENTLESS	1	קומפלט		
2.	גשרון	3	יח'		
3.	מדף סלים משופע	1	יח'		
4.	סל פלסטיק 50/50 ס"מ לצלחות ומגשים – פתוח בצדדים	25	יח'		
5.	סל פלסטיק 50/50 ס"מ לצלחות וכוסות	25	יח'		
6.	סל פלסטיק 50/50 ס"מ לכוסות וקעריות	25	יח'		
7.	סכומון	60	יח'		
7א.	מנגנון פיקוד להפעלת המדיח בשבתות וחגים המאושר ע"י מכוני ההלכה.	1	יח'		
סה"כ לסעיפים 1-7					
8.	עלות שנת שרות, כולל חלפים, בתום תקופת האחריות, היינו לאחר 3 שנים.	1	קומפלט		
9.	עלות שנת שרות, ללא חלפים*, בתום תקופת האחריות, היינו לאחר 3 שנים.	1	קומפלט		



* על המציע לצרף להצעתו מחירון חלפים מחייב, לכל מרכיבי המערכת, ולציין בנספח א' למסמך א' מהו אחוז הנחה מהמחירון. אחוז הנחה בפועל יהיה מהמחירון שהוגש במסגרת המכרז או מהמחירון שיהיה בתוקף במועדים הרלוונטים אצל המציע, הנמוך מביניהם. למזמין בלבד שמורה האופציה לנהל משא ומתן לעניין מחירי החלפים.

- (1) המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.
 - (2) המזמין שומר לעצמו האופציה להזמין שירות לשנתיים נוספות, שנה אחת בכל פעם, בתום תקופת האחריות, בהתאם לסעיף 8 או 9 להצעת המחיר.
 - (3) המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו ואת הכמויות. שינויים בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אשר מולאו בטופס הצעת המחיר.
 - (4) אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר הרשום לצידו של הפריט, לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה ו/או תתגלה אי התאמה בחישוב כל השורות בטבלה לבין הסה"כ הכללי, הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה.
- לחלופין, תהא וועדת המכרזים של המזמין רשאית להשלים המחיר בנוגע לאותם פריטים כאמור, כך שיילקח בחשבון מחיר היחידה הגבוה ביותר שהוצע במכרז על ידי מי מהמציעים במכרז. יובהר כי ככל שהמזמין יתקן מחירי היחידה כאמור לעיל למחיר הגבוה ביותר שהוצע על ידי מי מהמציעים, והמציע יזכה במכרז, יחויב המזמין בפועל עבור אותם פריטים שתוקנו במחיר היחידה הנמוך ביותר שהוצע במכרז על ידי מי מהמציעים.
- מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים בטופס הצעת המחיר, יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של הצעת המחיר ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שיבוצע המנגנון לעיל, או שהצעתו תפסל, הכל לפי נסיבות העניין ושיקול דעת וועדת המכרזים.

פרטים משלימים

תפוקה ק"ג/שעה	נידוף CFM	מים (1)	חשמל (2)	תצרוכת דטרונטים	מהירות	גובה	רוחב	אורך	דגם קטלוגי	יצרן	שם הפריט	
											מדיח סלים (מוביל פנימי) עם מסוע "קרוסלה" 360 מעלות	1
											מדף סלים משופע	2
											גשרון	3

- (1) צריכת מים בליטרים לשעת פעולה רציפה
 (2) צריכת חשמל ב- KW לשעת פעולה רציפה

19. חתימת המציע על טופס ההצעה

שם המשתתף _____ כתובת _____
 טלפון _____ טל. סולרי _____ פקס. _____
 דואר אלקטרוני _____ איש הקשר _____

_____ תאריך

_____ חתימה וחותמת

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____
מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי היום _____
חתמו בפני ה"ה _____ ת.ז. _____
וה"ה _____ על מסמכי מכרז מספר _____

_____ חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח

_____ תאריך

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____
מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף
חתימותיהם של ה"ה _____ ת.ז. _____ ו-
_____ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _____

זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

_____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____ תאריך