

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

מכרז מס' 11999622 - נ ס פ ח א'

דרישות למכרז מסגרת לרכישת מנורות בדיקה

1. נדרשות הצעות מחיר לרכישת מנורות בדיקה בהתאם למפורט.

הבהרות:

- כל דרישה במכרז מהווה דרישת סף למעט דרישה המוגדרת כיתרון או עדיפות.
- הצעה אשר לא תלווה בקטלוגים מפורטים ומודגשים והבהרות בהתאם לכל דרישה פרטנית במכרז תיפסל על הסף.
- תוקף המכרז 5 שנים – יש לאשר בכתב.
- יש לספק מספר טלפון וכתובת מייל לטובת שאלות והבהרות.

2. **להלן הדרישות:**

הבהרה:

בדרישות מופיעות 5 קטגוריות שונות.
בכל קטגוריה יש לספק הצעה לדגם המתאים ביותר והעונה לדרישות, יש להגיש הצעה
אך ורק לקטגוריות רלוונטיות בהן יש ליצרן דגם מתאים להציע.


מנורת בדיקה ניידת

קטגוריה א

- מנורת בדיקה בעלת גוף תאורה קומפקטי - יש להציע בקטגוריה זו את הדגם הקומפקטי ביותר המוצע על ידי היצרן
- עוצמת תאורה בטווח 30,000-60,000 lux
- טמפי תאורה בטווח 4000-4500 K

קטגוריה ב

- עוצמת תאורה של לפחות 60,000 lux
- טמפי תאורה בטווח 4000-4500 K

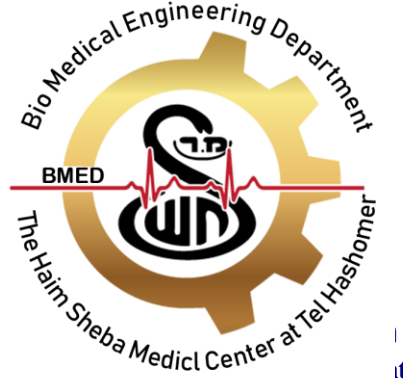

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ההצעות יכללו עגלה ייעודית ניידת וזרוע הכוללת לפחות 3 מפרקים (כולל נקי חיבור לגוף התאורה). יש לספק שרטוט.

מנורת בדיקה לתלייה מהקיר

קטגוריה א

- עוצמת תאורה בטווח 30,000-60,000 lux
- טמפי' תאורה בטווח 4000-4500 K

ההצעה תכלול זרוע תלת מפרקית המתאימה לתליית המנורה מהקיר. יש לספק שרטוט. ההצעה תכלול את כל רכיבי הזרוע והעיגון (כולל flange) ואת עלויות ההתקנה.

התקנה באתר בפועל תבוצע לאחר אישור בהתאם לנתוני אתר ההתקנה.

קטגוריה ב

- עוצמת תאורה בטווח 30,000-80,000 lux
- טמפי' תאורה בטווח 4000-4500 K

ההצעה תכלול זרוע תלת מפרקית המתאימה לתליית המנורה מהקיר כאשר לפחות אחד המפרקים מאפשר תנועה ב-2 מישורים לפחות. יש לספק שרטוט. ההצעה תכלול את כל רכיבי הזרוע והעיגון (כולל flange) ואת עלויות ההתקנה.

התקנה באתר בפועל תבוצע לאחר אישור בהתאם לנתוני אתר ההתקנה.

מנורת בדיקה לתלייה מהתקרה


- עוצמת תאורה של לפחות 50,000 lux
- טמפי' תאורה בטווח 4000-4500 K

ההצעה תכלול זרוע תלת מפרקית המתאימה לתליית המנורה מהתקרה כאשר לפחות אחד המפרקים מאפשר תנועה ב-2 מישורים לפחות. יש לספק שרטוט. ההצעה תכלול את כל רכיבי הזרוע והעיגון (כולל flange) ואת עלויות ההתקנה.

התקנה באתר בפועל תבוצע לאחר אישור בהתאם לנתוני אתר ההתקנה.

3. מתח הזינה יהיה חד פאזי 230V/50Hz.

4. ההצעה למכרז תהיה לדגם המתאים בגרסתו האחרונה והחדשה ביותר.

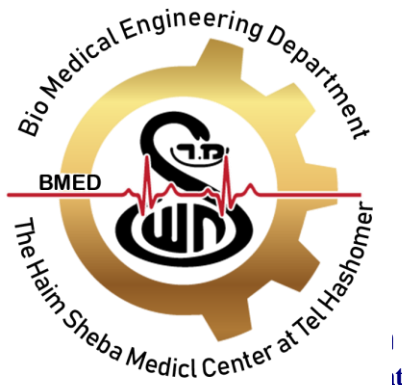


טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3

5. יש לציין תקנים בינלאומיים בהם עומד הדגם המוצע ולצרף אישור מכון אובייקטיבי לעמידות בהם. על הדגם המוצע לעמוד בתקן FDA/CE.
6. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור אנליטי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 61010 למכשור המשמש למדידה, בקרה ומכשור מעבדתי.
7. ליצרן סוכן מקומי, בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בתחום והמסוגל לגבות בידע, בשרות ובחלפים, בהתאם לכללי המקצוע הטובים ובלוח זמנים סביר.
8. תסופק ספרות כמפורט להלן:
 - א. ספר הפעלה בכמות 2 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.
 - ב. ספר שרות מסוג SERVICE MANUAL בכמות 1 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.
9. יש להגיש שמות ממליצים בארץ לדגם המוצע תוך פירוט שמותיהם ומס' הטלפון, שם ביה"ח בו מצוי הדגם המוצע ותקופת השימוש בו.
10. יש לציין תקופת אחריות מרבית כוללת לחלפים ולעבודה מיום תחילת השימוש בפועל בביה"ח ולא מיום קליטתו במחסני ביה"ח (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים).
11. היצרן באמצעות נציגו, יתחייב לבצע את כל הטיפולים המונעים התקופתיים בתקופת האחריות ובתקופת השירות בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. אי ביצוע טיפול מונע כלשהו בזמן, יגרום להארכת תקופת האחריות או השירות בפרק הזמן האקוויולנטי.
12. ההצעה תכלול רשימת חלקי חילוף עיקריים לדגם המוצע (בלאי ותקלות נפוצות). הרשימה תכלול עלויות.
13. ההצעה תכלול פירוט הצעת/דרישת היצרן לטיפולים ובדיקות תקופתיות בליווי העתק דרישת היצרן.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

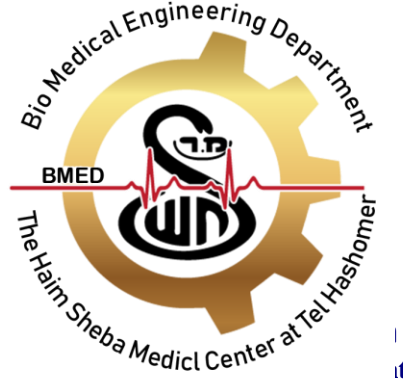

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4

מכרז מס' 11999622 - נ ס פ ח ב'

אמות המידה לבחירת ההצעה יהיו כדלקמן:

1. עלות 70%

2. חווי"ד משתמש קצה 30%

סה"כ 100%