

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	כ"י י"א
יחידה מזמינה:	הנ"ס, רפ"א א"י
תאריך:	30/1/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095073037	AFFINITY 70 ULTRASOUND SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$37,528+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621. ISRAEL

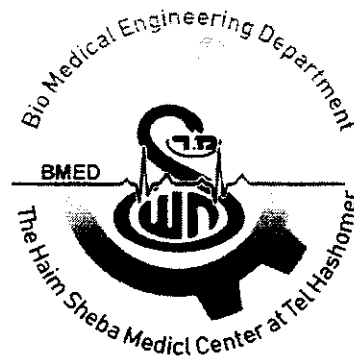

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 בינואר 2020
מספרנו: יש/2020-0045
תיק: 2-1125, 4503

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן
נכבדתי,

הנדון: מח' פגים – חו"ד להחלפת אולטראסאונד קרדיאלי

בדגם CX-50, מס' סדי USD0800809 קיימת תקלה המחייבת החלפת מחשב המכשיר.
דגם זה הוכרז ע"י היצרן פיליפס כ-E.O.L ואינו מצוי בתמיכה. המכשיר יושבת.
חבי מדטכניקה הציעה כחלופה דגם AFFINITY 70 המקובל על דרי אוריאל כפי בשתי גרסאות:
א. גירסה הכוללת אפליקציה קרדיולוגית ורדיולוגית (הצעת מחיר 202500430).
ב. גירסה הכוללת אפליקציה קרדיולוגית בלבד למכשיר בן שנתיים (דוא"ל חבי מדטכניקה מיום 26.1.2020).
להדגיש כי התוכנות והמתמרים הקיימים בדגם CX-50 תואמים עם דגם AFFINITY 70 ולכן ההחלפה הינה למכשיר בלבד ללא מתמרים וללא תוכנות.
דגם AFFINITY 70 מאושר ע"י מערכות מידע.
שתי הגרסאות קבילות על דרי כפי.
מומלץ לממש לפי שיקול כלכלי.
ניתן לראות היצרן פיליפס ספק בלעדי להחלפת המכשיר התקול במכשיר חלופי.
תינתן אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמני
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הכתובת רלבנטית

העתקים: פרופ' ציפי שטראוס
דרי איתי פסח
דרי אוריאל כפי
דרי יורם שדמני