

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(הבריאות)
יחידה מזמינה:	מתאן פזים
תאריך:	19/2/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084034	MU20508 GLOBETROTTER 500 W/MVP-10 VENTILATOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	עמוס גזית
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____    ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	64,000 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

4 בפברואר 2020  
מספרנו: עש/2020-0055  
תיק: 1-1129, 4503

לכבוד  
גבי גאולה נעים  
כאן

נכבדתי,

**הנדון: מחלקת פגים – חו"ד לרכישת אינקובטור להעברות**  
דוא"ל פרופ' שטראוס מיום 26.01.2020

1. בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 2 יח.
2. להלן תכונות המכשיר הנדרשות:

**אינקובטור:**

אינקובטור סגור בעל דפנות שקופות כפולות ואפשרות פתיחה מהירה לטיפול/הוצאת היילוד.

**מערכות בקרה:**

- בקרה וניטור על טמפי בחלל האינקובטור וניטור טמפי עור
- בקרה וניטור חמצן בחלל אינקובטור

**התראות:**

המערכת תכלול התראות מערכת, סוללה, טמפי, חמצן וטמפי עור (באם קיים ניטור).

**מכשור מובנה:**

- מנשם ובלנדר
- סקשן
- קומפרסור (מדחס)
- תאורה אינטגרלית

**רכיבים ומאפיינים נוספים:**


- עגלה ייעודית מותאמת לנשיאת האינקובטור, המכשור המובנה, בלון חמצן גדול בנפח 10 ליטר ועמודי עירוי ומרחב אחסון.
- מוט עירוי בעל מספר מצבי גובה (2 יחידות)
- אחסון ומגש טיפולים
- סוללה לפעולה של לפחות 3 שעות בהפעלה מלאה.
- מתח זינה חד פאזי 230V/50Hz.

3. לאחר בדיקה של דגמים V-808 תוצרת ATOM ו-TI500 תוצרת Drager, נמצא כי הדגם היחיד העונה לדרישות הוא TI500 Globe-Trotter.

- א. דגם זה הינו היחיד הכולל עגלה ייעודית. שאר הדגמים שנבדקו הינם למעשה אינקובטורים המוצבים על עגלות נידוד מתקפלות סטנדרטיות שנמצאו לא מתאימות לשימוש ואינן מאפשרות אחסון בלון חמצן גדול כנדרש.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית-הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

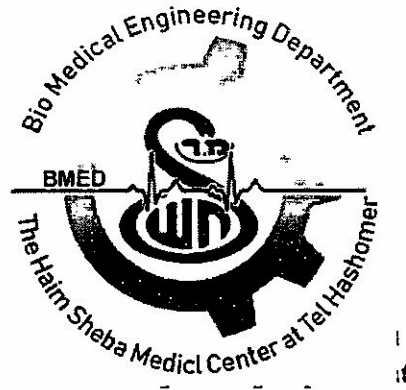

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

- ב. דגם זה הינו היחיד הכולל את כל המכשור המובנה הנדרש להעברות פגים. האינקובטור כולל מנשם, סקשן, קומפרסור ותאורה אינטגרלית.
  - ג. דגם זה הינו היחיד שנמצא עונה לדרישות המבנה והאחסון וכולל מגש טיפולים, שני עמודי עירוי ומקום אחסון.
  - ד. בדגם זה נמצאו יתרונות נוספים כגון אפשרות לקיפול מדפים בעגלה לשם אחסון.
  4. יש לממש הצעת מחיר 18Q07700 של חברת גזית לדגם TI500 Globe-Trotter תוצרת Drager. יש לממש ההצעה במלואה בכמות של 2 יחידות. בהתאם לפירוט ולתוצאות הבדיקה, ניתן לראות ביצור ובנציגו ספק בלעדי לרכישה. ההצעה כוללת: אינקובטור סגור, עגלה ייעודית מותאמת, קומפרסור, בלנדר, מנשם אינטגרלי, עמודי עירוי ומגירת אחסון, מערכות בקרה וניטור, 2 סוללות לניוד, כניסות לאספקת גזים ויציאת לחיבור לחשמל.  
יש לכלול בהזמנה ספרות שירות והפעלה כנדרש.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשירים שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

ב-ר כ-ה,  
ענבר אמוץ-טוישן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופי שטראוס ציפי  
ד"ר שדמי יורם  
גבי מקדש קרן