

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הרביע א)	
יחידה מזמינה: הפניק רח ארני - IVF	
תאריך: 12/3/20	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095084158	K-MAR-5200 DIGITAL REGULATED VACUUM PUMP
1	1095051520	ADJUSTABLE HANDLE F.PIPETT-FLEXIPET K-MPH-1000

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטאי-פסח	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_


סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____    ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,160 + מע"מ



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

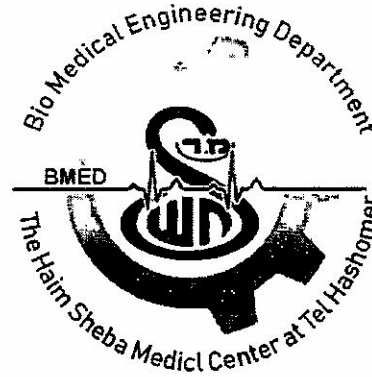

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

27 בפברואר 2020  
מספרנו: מב/0087-2020  
תיק: 4006, 1111-5

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

**הנדון: הפריה חוץ-גופית/IVF – חו"ד לרכישת מכשיר לשאיבת ביציות.**

דוא"ל מיום 11.2.19

בסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות 1 יח.

בשימוש יח' IVF מכשיר לשאיבת ביציות אחד בלבד מדגם K-MAR-5200 תוצרת COOK MEDICAL.

פעולת שאיבת ביציות מתבצעת בח.נ גניקולוגי כ-7 פעמים ביום במשך 6 ימים בשבוע. במצב זה, כל תקלה במכשיר הקיים אשר איננה ניתנת לתיקון מדי, עשויה לגרום לעיכובים ואף להפסקת העבודה. היות ופעילות שאיבת הביציות כולה נסמכת על שמירתו וביצועיו של מכשיר אחד, קיים צורך חיוני ברכישה של מכשיר גיבוי.

מדובר במכשיר בעל התכונות הבאות:

ואקום מדויק ומבוקר בעל ספיקה נמוכה אשר הינו ייעודי לשאיבת ביציות.  
ויסות ואקום בתחום (-500)mmHg – -30.  
אפשרות לשאיבה רגעית ומוצאת לצורך פתיחת סתימה.  
אפשרות לשליטה באמצעות דוושת רגל.

מאחר ולא ידוע על מכשיר אקוויולנטי לדגם K-MAR-5200 המשווק בארץ, ניתן לראות ביצרן COOK MEDICAL באמצעות חברת "גטר-גרופ" ספק יחיד לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 05003739 במלואה.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בבדכה,  
מיטל בקסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ראול אורביטו  
ד"ר אדוה עזר  
ד"ר יורם שדמי