

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הבריאה)
יחידה מזמינה:	הפניה חר אג"פ - EKF
תאריך:	12/3/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095084158	K-MAR-5200 DIGITAL REGULATED VACUUM PUMP
1	1095051520	ADJUSTABLE HANDLE F.PIPETT-FLEXIPET K-MPH-1000


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטאי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,160 + מע"מ

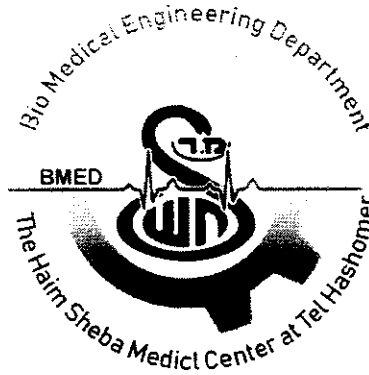

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 בפברואר 2020
מספרנו: מב/0087-2020
תיק: 5-1111, 4006

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: הפריה חוץ-גופית/IVF – חו"ד לרכישת מכשיר לשאיבת ביציות.

דוא"ל מיום 11.2.19

בסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.

בשימוש יח' IVF מכשיר לשאיבת ביציות אחד בלבד מדגם K-MAR-5200 תוצרת COOK MEDICAL.

פעולת שאיבת ביציות מתבצעת בח.ג. גניקולוגי כ-7 פעמים ביום במשך 6 ימים בשבוע. במצב זה, כל תקלה במכשיר הקיים אשר איננה ניתנת לתיקון מידי, עשויה לגרום לעיכובים ואף להפסקת העבודה. היות ופעילות שאיבת הביציות כולה נסמכת על שמישותו וביצועיו של מכשיר אחד, קיים צורך חיוני ברכישה של מכשיר גיבוי.

מדובר במכשיר בעל התכונות הבאות:

ואקום מדויק ומבוקר בעל ספיקה נמוכה אשר הינו ייעודי לשאיבת ביציות.
ויסות ואקום בתחום (-500)mmHg – -30.
אפשרות לשאיבה רגעית ומוצאת לצורך פתיחת סתימה.
אפשרות לשליטה באמצעות דוושת רגל.

מאחר ולא ידוע על מכשיר אקוויולנטי לדגם K-MAR-5200 המשווק בארץ, ניתן לראות ביצרן COOK MEDICAL באמצעות חברת "גטר-גרופ" ספק יחיד לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 05003739 במלואה.

על החזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הסליטה ושימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בנוכח,

מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פריפי ראול אורביטו
ד"ר אדוה עזר
ד"ר יורם שדמני

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

עזר אדזה, דר
יום שלישי 11 פברואר 2020 19:06
שדמי יורם, דר; יוסף מרים
בקשה לרכישת מכשיר לשאיבת ביציות
משאבת ביציות.pdf

ד"ר שדמי שלום

ליחידה להפריה חוץ גופית משאבת ביציות אחת בלבד.

פעולת שאיבת ביציות מתבצעת בממוצע 6-7 פעמים ביום 6 ימים בשבוע.

מבקשת לרכוש עבור יחידת IVF מכשיר לגיבוי.

מצורפת הצעת מחיר. המשווק הינו ספק יחיד היות ואין בארץ חברה אשר משווקת מוצר מקביל.

תודה ובברכה
אדזה
מנהלת מעבדת IVF