

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הגנאים	משרד:
מ"מ / מ"מ / מ"מ / מ"מ	יחידה מזמינה:
17/6/20	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070512	CRYOSTAT LEICA CM1860UV
3	1040019176	PARKING STATION 1860
2	1040019168	HEAT EXTRACTOR ASSY


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רניום
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ _____

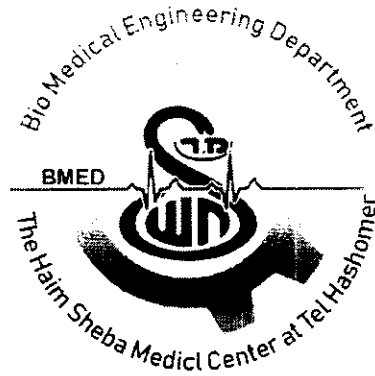

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 ביוני 2020
מספרנו: יש/2020-0313
תיק: 7015-5, 1219-2

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ן

הנדון: מט"מ/מעבדת מוהס – חוו"ד לרכישת קריאוסטט

דוא"ל מיום 15.6.2020

1. נדרשת החלפה דחופה של המכשיר הישן המצוי בשימוש דרי אבינועם עקב בעיית טמפי שאינה ניתנת לתיקון לנוכח הבלאי במכשיר. הניסיונות לתיקון לא הביאו לקבלת הטמפי הנדרשת. המכשיר הישן והלקוי הינו מדגם 1850CM תוצרת LEICA ונקלט במאי 2006.

מדובר במכשיר חיתוך חצי אוטומטי לעבודה שוטפת, קרי – ביצוע חתכים קפואים במהלך טיפול רפואי/ניתוח על מנת להחליט על המשך הטיפול הכירורגי הנדרש.

מדובר בדגם בו פעולת החיתוך מבוצעת ידנית ואולם קידום הדגימה (הרקמה) מבוצע באמצעות מנוע פסיעות (STEPPER MOTOR), המשמש גם ל-TRIMMING (חיתוך גס של פריט הדגימה שאינה רלבנטית לחיתוך הדרוש).

המכשיר כולל את המרכיבים הבאים:

- א. מעי הקפאה מהירה לדגימה.
- ב. תנועת הדגימה במרחב בשלושת הצירים.
- ג. מעי הפשרה אוטומטית.
- ד. מנגנון עבור AntiRoll לקבלת חיתוך פרוס ישר.
- ה. מעי עיקור באמצעות UV.


2. בחודש אפריל 2015 נקלט מכשיר דגם CM-1860UV כתחליף למכשיר ישן מתוצרת רייכרט.

בשימוש דרי גלית אבינועם שני מכשירים דגם CM-1860UV תוצרת LEICA. על מנת לשמור על אחידות המכשור וההפעלה נדרש דגם נוסף זהה. יש לפיכך לממש הרכישה לדגם CM-1860UV

הערה: בעברה הובהר כי לשני יצרנים נוספים אין מענה ואין התאמה לנדרש ניצן ו-SLEE ו-SAKURA קיים יתרון רב בזהות המכשירים כנוחות התפעול.

דרי גלית אבינועם הבהירה את שביעות רצונה המלאה מדגם ה.

לנוכח הנייל מומלץ למכוש הצעת חבי רניום הרצויים על כל סעיפיה, כאשר לנוכח הנסיבות ניתן לראות היצרן ונציגותו המיקומית ספק בלעדי לרכישה.

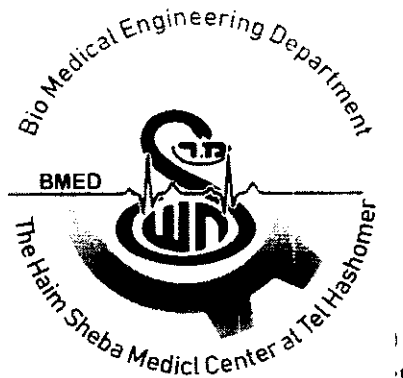

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ההצעה כוללת את הפריטים הבאים:

1. המכשיר.
 2. בסיס מחזיק הסכין.
 3. מחזיק סכין אוניברסלי לסכינים צרים ורחבים.
 4. מע' קירור פלטייה לקירור מהיר עבור 2 תחנות.
 5. מנגנון עיקור באמצעות UV.
 6. Heat Extractor לשיטוח הדגימה לפי החיתוך לקבל חתך מדויק.
 7. משטח להנחת Heat Extractor לשמירת הטמפי של הדגימה.
- תקופת האחריות תהיה כמקובל בביה"ח, דהיינו לפחות 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל במכשיר.
- ההזמנה תכלול ספרי שרות והפעלה.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר גלית אבינועם
ד"ר יובל לוי
ד"ר יורם שדמי