

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	(המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא)
יחידה מזמינה:	קרק תל אביב
תאריך:	29/06/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095069118	MEGAFUGE 16 ROBUST TABLE-TOP CENTRIFUGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	13,980 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

21 ביוני 2020
מספרנו: יש/2020-0320
תיק: 2-1124, 4008

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: בנק הזרע – חוו"ד לרכישת צנטריפוגה שולחנית מסוג ביו-האזרד

תכתובת בדוא"ל מיום 16.6.2020

- בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח.
 - מדובר בצנטריפוגה בעלת התכונות הבאות:
 - רוטור מסוג SWING-OUT הכולל מכסים לביו-האזרד, מהירותו לפחות 5000 סל"ד, תאוצתו הצנטריפטלית (RCF) לפחות 4500g.
 - יכולת סירכוז בו-זמנית של:
 - 16 מבחנות קוניות בנפח 50ml כ"א
 - 36 מבחנות קוניות בנפח 15ml כ"א
 - 56 מבחנות בנפח 10ml להפרדת דם
 - זינה חשמלית – 230V/50Hz
 - בשימוש בנק הזרע צנטריפוגה דגם 16 MEGAFUGE תוצרת HERAEUS הכוללת רוטור Swing-out דגם TX-200 המאפשר מחזור סירכוז של 180ml.


הבהיר דרו' אטקוביץ כי בהתאם לדרישת מנהל המרכז עליו להגדיל את כמות התורמים באופן משמעותי, פועל יוצא הגדלת יכולת הסירכוז באופן משמעותי. הן בכמות הכוללת והן במחזור הסירכוז.

מאחר וקיימות שביעות רצון מוחלטת מדגם 16 Megafuge, מתבקשת רכישת דגם זהה על מנת להגדיל הכמות מחד גיסא ושימוש ברוטור מדגם TX-400 המאפשר מחזור סירכוז הגדול למעלה מכפול מהקיים ועומד על 400ml וייתן מענה להגדלת מחזורי הסירכוז מאידך.

רכישת צנטריפוגה מדגם זהה תאפשר גם ליבוי הדדי בעת הקלה כלשהי כי ניתן להעביר כל הפרטים בין שתי הצנטריפוגות, אופן הרפעה זהה ובין גם ה-Buckets, כך שצורך צנטריפוגה מדגם זהה תאפשר הסתייגות מירבית ומייטבית.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית-הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

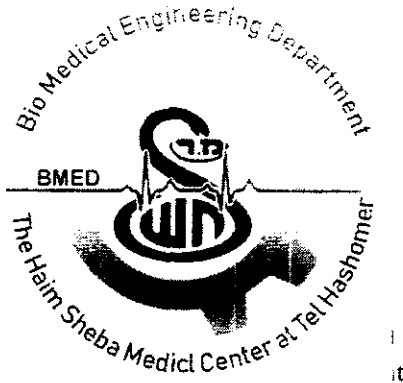

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

רצ"ב הצעת חבי לבנט למימוש הרכישה אותה יש לממש על כל סעיפיה.
מהאמור לעיל ניתן לראות ביצרן HEREAUS ספק בלעדי לרכישה זו.
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה במעבדה.

נסלכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר
העתקים : ד"ר ניר אטקוביץ
ד"ר יורם שדמי