



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 202887

יחידה מזמינה: רפואה גרעינית

מהות הרכישה: החלפת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE 68

סכום הרכישה מטבע ספק: 81,607 ש"ח כולל מע"מ.

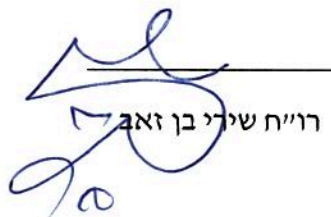
ספק פוטנציאלי: GE

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 18 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 18 חודשים הינו 81607 ש"ח כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 54 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 944821 באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 20.7.20 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


רו"ח שירי בן זאב


עו"ד רועי אדרי


אשר מזרחי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

16 ביולי 2020

סימוכין: 11-07

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

אדוניים נכבדים,

**הנדון: החלפת (רכישת מקור קרינה מסוג (GE-68 PET Annulus DQA Imaging 55mbq) עבור מערכת
במכון רפואה גרעינית**

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET/CT, דגם: Discovery MI, מס"ד ב"ח: 23304, יצרן: חבי G.E.,

סוכן: G.E. HEALTHCARE, הכוללת מקור קרינה מסוג GE-68 PET Annulus DQA Imaging 55mbq.

במערכת PET/CT יש צורך להחליף מקור קרינה עקב החלשות המקור מסוג GE-68 PET Annulus DQA Imaging 55mbq,

שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפו כל 18 חודשים.

המקור נדרש לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע.

נכון להיום המקור חלש מאוד. כשהמקור חלש עלולות להופיע בעיות מגוונות ושונות בתפקודי המערכת

ופגיעה באיכות התמונה ומקשה מאוד על עבודת המחלקה.

על כן ממליץ לרכוש מקור קרינה מסוג GE-68 PET Annulus DQA Imaging 55mbq חדש.

היותו מקור קרינה זה הנו חלק חשוב למערכת.

יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובחבי G.E. ספק יחיד למקור קרינה מסוג GE-68 PET Annulus DQA Imaging 55mbq.

למקרה זה.

בברכה,

שמיר ירון
ראש צוות דימות

