

אל:
ועדת המכרזים
דורות - מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, על הוראות תכ"ם "פטור ממכרז" מס' 7.3.6.1 ועל הוראות תכ"ם "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים" מס' 7.3.6.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
החלפת ציוד רפואי בתחום גזים רפואיים במטרה להתאים רשת הגזים הרפואיים לדרישות הנוהל G01 של משרד הבריאות ולתקנים הבין לאומיים במרכז גריאטרי בכלל ובמחלקות האשפוז בפרט. בהתאם לנהלים ותקנות שיצוינו להלן נדרשת החלפת שקעים ותקעים לגזים רפואיים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר (סמן X במקום המתאים):
 כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
 טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	זילברמן טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ע.מ.)	510542202
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 600,000
תקופת ההתקשרות:	שנה אחת

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

נעשתה פנייה ליועץ גזים רפואיים מורשה מר יוסי לביא, שהתבקש לבדוק קיומן של חברות נוספות בשוק המסוגלות לספק ולהתקין שקעי גזים רפואיים ENV 737-6 (ISO 9170-1) במקום השקעים והתקעים הקיימים בחלק מהמבנים. בעקבות הבדיקה שעשה, הופק דו"ח בנושא.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).

ככל הידוע לי והיועץ גזים רפואיים יוסי לביא חיזק והעיד בחוות דעתו כי נכון להיום לשקעים והתקעים שקיימים במרכז הגריאטרי קיים ספק יחיד בארץ. מדובר בשקעים ובתקעים לגזים רפואיים מסוג Double Parking העונים לדרישות התקן ENV 737-6. ספקים אחרים אינם מסוגלים לספק את הציוד הנדרש, לציוד דומה (שיכול היה להוות ציוד שווה ערך) של חברות אחרות עדיין אין אישור אמ"ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) של משרד הבריאות.

לכן השקעים מסוג **Double Parking** של חברות אחרות כמו כל ציוד רפואי אחר אסורים לשימוש במוסדות רפואה כל עוד לא קיבלו אישור אמ"ר.
לכן, לחברת זילברמן ישנה בלעדיות מעשית לסוג זה של השקעים גם אם לא מוצהרת רשמית.

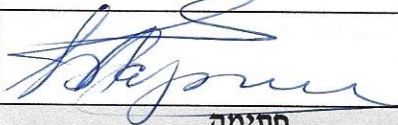
3. נימוקים והערות נוספות:

ראוי לציין כמה עובדות מכריעות:

- הנוהל של משרד הבריאות **G01** "מערכות גזים רפואיים" במהדורתו העדכנית 2021 בכללותו הינו נוהל רשמי ומחייב. לכן כל הדרישות שבנוהל מחייבות כל מוסדות הרפואה בארץ.
- הנוהל (פרק משנה 2.14) מחייב להחליף כל השקעים והתקעים במוסד הרפואי לשקעים ותקעים בהתאם לתקנים בינלאומיים תוך שמירה על אחידות השקעים בכותלי המוסד כולו, כי חוסר ההתאמה עלולה לגרום לטעויות וכשלים בתפקוד הציוד הרפואי **ולכן נחשבת כמסוכנת ופסולה**.
- הדרישה לאחידות מודגשת בצורה ברורה ומקבלת משנה תוקף בסיכום דיון בלישכת מנהל הכללי של משרד הבריאות (מס' סימיכין 551584221) בנושא גזים רפואיים מיום 12.7.2021. בין היתר בסיכום מצוין: המוסד הרפואי רשאי לבחור תקע אחד מתוך השלושה, אך נדרש לשמור על אחידות בכל מוסד רפואי באותו שקע (ההדגשה שלי).
- כיום, כאמור בדוח היועץ, במרכז הגריאטרי דורות קיימות ארבע מחלקות אישפוז בשני מבנים, בהן מותקנים שקעים תקינים (ISO 9170-1) **ENV 737-6** מסוג **Double Parking**.
- **אי לכך, כדי לשמור על אחידות השקעים והתקעים מחד ומאידיך כדי להימנע מבזבז משאבים ולמנוע סיכונים מיותרים הטמונים בהחלפת שקעים בארבע מחלקות האלה התקבלה החלטה מושכלת להמשיך ולהשלים את הפרויקט של החלפת השקעים והתקעים בשאר המחלקות בהתאם לסוג הקיים במרכז הגריאטרי היום.**

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי, חבר בוועדה המייעצת לנוהל G01	אינג' גנאדי ברנצ'יק
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית