



20/08/2026

לכל המציעים,

הנדון: מכרז מס' 6538/2026 - ערכות חד פעמיות לצנתור ואפידורל

הודעה מס' 1 – עדכונים למסמכי המכרז, דחיית מועדים ותשובות לשאלות והבהרות

1. בהמשך למכרז שבנדון שפורסם ביום 22.7.2026 מצ"ב עדכונים למסמכי המכרז, דחיית מועדים ומענה לשאלות והבהרות.
2. **לחלן עדכונים למסמכי המכרז ודחיית מועדים:**
 - 2.1. **נספח "ב" – כתב כמויות והצעת מחיר** - התווסף פריט מספר 4 "ערכה חד פעמית לצנתור לאנגיוגרפיה". על המציע למלא את הצעת המחיר על גבי נספח **מעודכן** המצורף להודעה זו.
 - 2.2. **נספח "ג" – מפרטים טכניים** – מצ"ב מפרט טכני לפריט מספר 4 "ערכה חד פעמית לצנתור לאנגיוגרפיה".
 - 2.3. לאור האמור, ניתן להגיש שאלות הבהרה **לפריט מס' 4 בלבד – "ערכה חד פעמית לצנתור לאנגיוגרפיה"**, וזאת עד ליום **25.8.2026** בשעה 12:00.
 - 2.4. מועד הגשת ההצעות **נדחה ליום 2.9.2026 בשעה 12:00** (חלף 24.8.2026). הצעות יוגשו במערכת Sourcingvision, בהתאם להוראות המכרז. לאחר מועד זה תינעל התיבה האלקטרונית ולא ניתן יהיה לבצע פעולות נוספות במערכת.
3. יתר התנאים של המכרז – **נותרים ללא שינוי**.
4. הנכם נדרשים לאשר קבלת הודעה זו באמצעות הטופס המצורף **כנספח "א"** ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: s_osishouldiner@rmc.gov.il.
5. **מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.**
6. להבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ בטלפון : 04-7772391.

בברכה,

שירן שולדינר, עו"ד
עורכת מכרזים והתקשרויות
מחלקת רכש



נספח "א"

לכבוד,
המרכז רפואי רמב"ם – מחלקת רכש
לידי: שירן שולדינר, עו"ד
אימייל: s_osishouldiner@rmc.gov.il

גב' נכבדה,

הנדון: מכרז מס' 6538/2026
ערכות חד פעמיות לצנתור ואפידורל

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 1 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

שם פרטי	שם משפחה	שם החברה

חותמת חברה	חתימה



נספח "ב" – מעודכן

כתב כמויות והצעת מחיר

1. המציע ימלא הצעת המחיר על גבי נספח זה, לפי מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו ובהתאם למפרטים הטכניים המצ"ב כנספח "ג" לחוברת המכרז ולהודעה זו.

מ ס "	מק"ט רמב"ם	תיאור פריט	כמות משוערת לשנה	מק"ט יצרן	עלות ליחידה	מטבע	סה"כ
1	1021111	ערכות חד פעמיות לאפידורל	3,800				
2	1015617	ערכות חד פעמיות לצנתור	3,000				
3	1057208	ערכות חד פעמיות לצנתור לנוירורדיולוגיה	150				
4	1038420	ערכות חד פעמיות לצנתור לאנגיוגרפיה	1,000				
סה"כ לפני מע"מ							
סה"כ כולל מע"מ							

2. למחירים המצוינים לעיל יתווסף מע"מ על פי חוק.
3. ניתן להגיש הצעות גם לחלק מהפריטים המופיעים בכתב הכמויות.
4. כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה – רשאי המזמין, אך לא חייב לתקנה. ככל שתתקן טעות כזו, יתוקן בהתאם הסכום הכללי של ההצעה.
5. נא לצרף מפרט הפריט המוצע. לצורך הוכחת טיבם, איכותם ואישורם של המוצרים המוצעים נא לצרף כל מסמך המעיד על כך. הנתונים אשר יימסרו ע"י המציע לגבי האמור לעיל, ישמשו את המזמין בין היתר לבחינת המוצר ולעמידתו בדרישות המזמין.
6. הפריט יהיה חדש, לא מחודש, והשימוש בו יהיה חד פעמי ולא ממוחזר.
7. אין המזמין מתחייב להזמין את כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ו/או את כל הכמות המצוינות לעיל, חלק ממנה, או לא להזמין כלל. הכמויות הינן משוערות בלבד. יובהר כי לכל פעולה יוזמנו פריטים רלוונטיים מסעיפי כתב הכמויות, בהתאם לצורך.
8. למען הסר ספק, יובהר כי המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין ו/או לא להזמין את הפריטים והכמויות המצוינים לעיל.



9. יובהר כי במקרה שיידרשו למזמין פריטים שאינם מופיעים בהצעת המחיר, יתקיים מו"מ בין נציג המזמין לספק ויסוכם מחיר פרטני לכל פריט כאמור.

10. המציע מתבקש לציין לגבי כל פריט המוצע על ידו ושאינו בשימוש בית החולים, אילו מוסדות רפואיים משתמשים בפריט ולצרף עפ"י שיקול דעתו חוו"ד/המלצות של בתי חולים אחרים כולל רשימת אנשי קשר.

11. על המציע לספק לבית החולים דוגמאות תוך 7 ימים מבקשת המזמין, ככל שיתבקש לכך, לצורך בדיקה ואישור הפריטים. מציע אשר לא יגיש דוגמאות לבחינה, המזמין רשאי לראות בהצעתו כהצעה לא שלמה ולפוסלה.

קראנו בעיון את כל הפרטים של הצעה זו על כל נספחיה ומצהירים בזה שהבנו את הדרישות ושאו מסכימים לתנאיה ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו הנ"ל.

 תאריך

 חתימה וחותמת המציע

מפרט טכני

ערכה חד פעמית לצנתור לאנגיוגרפיה (מס"ד 4 בכתב הכמויות)

כמות ביחידות	תיאור פריט
20	פ"ג 8-10*100 יח' בתפזורת
1	מחט 25 G - כתום BD
4	BLUE TOWEL XR FOR SURGICAL ROOM
1	IMAGE COVER R-65
1	NEW TABLE COVER 152X250 CM
1	מוסקיטו עם שיניים עקום 35-211
2	מחט 18 OMG G
2	מזרק 10 סמ"ק OMG LS
1	מזרק 5 סמ"ק OMG LUER SLIP
1	מזרק 10 סמ"ק OMG LL
2	מזרק 20 סמ"ק OMG LS
1	גביע 150 CC
1	PINCE PORTE-AIGUILLE INOX (NEEDLE HOLDER)
1	Adson Forceps
1	Medical scissors blue 2cr13+PP
1	BASIN GUIDEWIRE 2500cc
1	Transparent Basin 250cc
1	Basin 1000cc
1	SHARPS HOLDER
2	DRAPE 100*100 W.Adh
1	DRAPE 100*200 W.Adh

✓ הערכה תהיה סטרילית ועטופה בשקית עיקור ייעודית עם שנץ לפתיחה ידידותית.



✓ תכולת הערכה תהיה עטופה בנייר עם עקרונות קיפול של פתיחה סטרילית.

✓ ע"ג האריזה החיצונית תפורט תכולת הערכה ויצוין שם הערכה.

על ההצעות להכיל את כל הפריטים הנדרשים בכל ערכה. שינוי ו/או החלפה ו/או העדר אחד או יותר מהפריטים יביא לפסילת ההצעה.

_____ חתימה וחותמת המציע: _____

_____ תאריך: _____

הנדון: מכרז מס' 6538/2026 - ערכות חד פעמיות לצנתור ואפידורל**תשובות לשאלות ובקשות להבהרות**

מס"ד	עמוד	מספר סעיף	פירוט השאלה / בקשת הבהרה	תשובה
1	3	11.1	המציע בתהליך לרישום האמ"ר שכולל מספר הבהרות לרכיבי הערכות. בהתאם המציע מתחייב להשלים את הרישום לפני הוצאת הזמנה. לפיכך, נבקש לשנות את תנאי הסף האמור מתנאי סף להשתתפות במכרז לתנאי סף להוצאת הזמנה.	ללא שינוי
2	3	11.1	לעניין הדרישה להוצאת אמ"ר במועד הגשת המכרז, מאחר שמדובר בסטים המיוצרים בהתאמה ייעודית לדרישות רמב"ם, נבקש לבדוק את האפשרות להנפיק את האמ"ר רק לאחר אישור הדוגמאות על ידכם	לא מאושר
3	3	12.2	אנא הבהרתכם איזה משקל יינתן לכל אחד מהפרמטרים שפורטו בסעיף וכיצד הם ינוקדו, האם באופן יחסי למציעים אחרים או על פי מדרגות ניקוד שייקבעו מראש. אם לפי מדרגות ניקוד, אנא פרט את המדרגות כאמור בהתאם לנדרש על פי דיני המכרזים.	קביעת ציון לכל מציע במסגרת סעיף האיכות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם לאמות המידה שפורטו. ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר בגין האיכות תקבל את הציון הגבוה ביותר (25) ויתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי להצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
4	נספח ג' עמוד 13	מפרטים טכניים כללי	נבקש לקבל דוגמה מכל סט לצורך ווידוא התאמת מפרט דרוש.	לא ניתן לקבל דוגמאות מהערכות נשוא המכרז. על המציע להגיש הצעתו בהתאם לדרישות ולמפרטים הטכניים המצורפים למכרז ולהודעה זו.
5	נספח ג' עמוד 13	מפרט טכני ערכה חד פעמית לאפידורל	חלוק בידוד כחול כהה, 45 גרם באפשרותו להציע חלוק בידוד בצבע צהוב. האם צבע זה יהיה מקובל?	בהתאם למפרט הטכני.
6	נספח ג' עמוד 13	מפרט טכני ערכה חד פעמית לאפידורל	פדי גזה בגודל 45x45 ס"מ נבקש לציין את מספר השכבות הנדרש.	8 שכבות.
7	נספח ג' עמוד 13	מפרט טכני ערכה חד פעמית לאפידורל	סדין אפידורל שקוף בגודל 130x75 ס"מ האם הסדין נדרש לכלול פתח או חלון? ככל שכן, נבקש לפרט את מיקומו ומידותיו. כמו כן, האם נדרשים אזורים מחוזקים או דביקים, ומהו החומר שממנו נדרש הסדין להיות עשוי? האם ניתן לקבל מפרט טכני?	הסדין עשוי ניילון שקוף PE וכולל פתח מלבני בגודל 9*20 ס"מ (20 אורך 9 רוחב), אשר ממוקם במרכז הסדין 43 ס"מ מלמעלה. ישנן 4-5 מדבקות מסביב לסדין.



8	נספח ג' עמוד 13	מפרט טכני ערכה חד פעמית לאפידורל	כוס בנפח 100 מ"ל באפשרותנו להציע כוסית מדורגת לתרופות בנפח 120 מ"ל. האם ניתן לאשר חלופה זו?	מאושר.
9	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	קערה כחולה בנפח 1,000 סמ"ק עם פס אדום האם הכוונה היא לקערה בנפח 1,000 מ"ל שעליה מודבקת תווית אדומה לצורך סימון תרופה?	כן.
10	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	סדין בגודל 100x100 ס"מ, 55 גרם האם הסדין נדרש להיות דביק או שאינו דביק? האם בד לא ארוג? האם ניתן לקבל מפרט טכני?	הסדין נדרש להיות דביק, עשוי מחומר SMS, בד לא ארוג.
11	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	סדין אנגיוגרפיה רדיאלי בגודל 370x275 ס"מ עם אזור סופג האם הסדין נדרש לכלול פתחים או חלונות? ככל שכן, נבקש לפרט את מספרם, מיקומם ומידותיהם. האם נדרשים אזורים מחוזקים או דביקים, ומהו החומר שממנו נדרש הסדין להיות עשוי? האם ניתן לקבל מפרט טכני?	כן, נדרשים 2 פתחים רדיאליים בקוטר 8 ס"מ ו- 2 פתחים פמורליים בקוטר 12 ס"מ.
12	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	נבקש לציין את המידות הנדרשות של העטיפה החיצונית.	100*100 ס"מ.
13	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	CUP 100CC WITH RED STRIP - למה כוונתכם ב red strip? האם הכוונה למדבקה אדומה שתודבק על גבי הכוס? האם נדרש כיתוב על המדבקה?	מדבקה אדומה מודבקת על גבי הכוס ללא כיתוב.
14	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	Mini Scalpel #11? האם הכוונה ל Thumb scalpel?	סקרפל עם ידית.
15	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	RADIAL ANGIO DRAPE 275*370 .WITH 230x375cm ABSORBENT האם המידה הזו תוכלו לעבוד איתה?	לא.
16	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	BOWL WITH RED STRIP 1000CC BLUE למה כוונתכם ב - BLUE strip האם הכוונה למדבקה כחולה שתודבק על גבי הכוס? האם נדרש כיתוב על המדבקה?	כוסית מסומנת בסרט אדום לסימון תרופה. לא נדרש כיתוב.
17	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	בכתב הכמויות מצוינת דרישה ל-10 קערות בנפח cc1500 נבקש לוודא האם הכמות אכן נכונה או שמדובר בטעות?	חלה טעות. BOWL 1500CC BLUE – במקום 10 יחידות יירשם – 1 יחידות.
18	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	נבקש להבהיר האם OUTER ARAP מיועד לעיטוף הערכה כולה, חיצונית, בנוסף לעיטוף הקיים באמצעות ה TABLE COVER?	כן.
19	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני	נבקש לציין איזה סוג Sharp Holder נדרש?	Foam – ספוג.



		ערכה חד פעמית לצנתור		
20	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	האם כמות פדי הגוזה 10*10 הינה 20 יחידות ככתוב במפרט.	כן.
21	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	כדורי גזה- מבוקש 10 כדורים, האם הם צריכים להיות מסומנים בפס זיהוי רנטגן?	כן.
22	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	מיני סקלפל - האם הכוונה ללהב ניתוח גודל 11 עם ידית מפלסטיק או ללא ידית?	כולל ידית.
23	נספח ג' עמוד 14	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור	OUTER WRAP מאיזה חומר צריך להיות עשויה העטיפה?	SMA.
24	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	מספריים סטנדרטיים באורך 12.5 ס"מ נבקש לציין את סוג המספריים הנדרש, לרבות צורת הלהבים והאם נדרשים מספריים ישרים או מעוקלים.	מספריים ישרים עשויים מתכת.
25	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	סט עירוי ארוך ללא פתח אוורור נבקש לציין את האורך והמידות הנדרשים של סט העירוי, וכן האם נדרש לכלול בו מסנן	סט עירוי עשוי PVC באורך 3.3 מ' ללא מסנן.
26	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	סדין אנגיורפיה בגודל 300x240 ס"מ, PE דו-צדדי האם הסדין נדרש לכלול פתחים או חלונות? ככל שכן, נבקש לפרט את מספרם, מיקומם ומידותיהם. כמו כן, האם נדרשים אזורים מחוזקים או דביקים, ומהו מבנה החומרים הנדרש מעבר ל-PE הדו-צדדי? האם ניתן לקבל מפרט טכני?	מצ"ב שרטוט מסומן כנספח "1" לשו"ת.
27	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	סט תוויות לאנגיורפיה נבקש לקבל פירוט של התוויות הנדרשות, לרבות הכיתוב, הצבעים, המידות והכמות מכל סוג. ככל שקיימת תמונה או דוגמה של סט התוויות, נבקש לצרפה למסמכי ההבהרות.	מצ"ב צילום מסומן כנספח "2" לשו"ת.
28	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	האם EMESIS BASIN וגם PLACENTA BASIN מדובר על כלי פלסטיק בצורת כליה בנפחים שונים? במידה ויש מאפיין מיוחד מעבר לכליה רגילה נבקש פירוט.	כלי פלסטיק סטנדרטי בצורת כליה ובצבע כחול. מצ"ב תמונה מסומנת כנספח "3" לשו"ת.
29	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	LIGHT HANDLE COVER האם מדובר בכיסוי ידית ירוק רגיל או כיסוי אוניברסלי?	כיסוי אוניברסלי.
30	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני	סט עירוי כתוב LONG נבקש הבהרה האם מדובר בסט 180 ס"מ?	ראה תשובה לשאלה 25 לעיל.




		ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה		
31	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	SURGICAL TOWL האם נדרש 12 מגבות כמו שכתוב או שזאת טעות הקלדה?	כן, בהתאם למפרט.
32	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	GAUZE PAD 10*10 האם מבוקש 40 פדים כמו שכתוב או טעות הקלדה?	כן, בהתאם למפרט.
33	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	נבקש להבהיר מה ההבדל בין שני סוגי המגבות הכחולות המופיעות במפרט, מלבד הגודל פריט. Surgical towel blue – מגבת 43*66 ס"מ, עשויה 100% כותנה בצבע כחול. O.R. Blue Towel 86x122 cm מגבת 122*86 ס"מ, עשויה 100% כותנה בצבע כחול.	
34	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	O.R. Blue Towel פריט 86x122 cm האם מדובר במגבת או בכיסוי? ומהו ייעודו?	ראה תשובה לשאלה 33 לעיל.
35	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	נבקש להבהיר למה מיועד CREPE PAPER 50*50 מהו הפריט שאותו הוא אמור לעטוף? האם מדובר במידה שגויה וייעודו עיסוף הערכה כולה?	נייר עטיפה בצבע ירוק העשוי מחומר סופג ומיועד לריכוז פריטים קטנים כך שלא יתפזרו.
36	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	CHG 2% Applicator 10.5ml Orange מאחר ומדובר על רכיב שהינו תרופה, האם יש אפשרות לספק הצעת מחיר ללא רכיב זה? אין אישור להכניס במפעל את התרופה כחלק מהמארז.	בהתאם למפרט הטכני.
37	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	O.R. Blue Towel 86x122cm האם הכוונה למגבת נייר חד פעמית או מבד? מאיזה חומר נדרשת המגבת?	ראה תשובה לשאלה 33 לעיל.
38	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	Angio Drape 240X300cm two side PE איזה סוג פתח נדרש? האם נדרש פתח הממוקם באזור המפשעה? Femoral Opening האם נדרש פתח הממוקם באזור שורש כף היד? - Radial Opening	ראה תשובה לשאלה 26 לעיל.
39	נספח ג' עמוד 16	מפרט טכני ערכה חד פעמית לצנתור לנוירודיולוגיה	Crepe paper 50X50cm Green האם מחייב להיות בצבע ירוק או שניתן לספק בצבע כחול?	ראה תשובה לשאלה 35 לעיל.
41	נספח ד' עמוד 19	2.7	נבקש לתקן את מועד האספקה הקבוע בסעיף, כך שהאספקות השוטפות תבוצענה בתוך 7 ימי עבודה, במקום 5 ימי עבודה, ממועד	בסיפא סעיף 2.7 יירשם: "אספקה ראשונה תבוצע לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד



קבלת דרישת האספקה. כמו כן, נבקש את אישורכם כי האספקה הראשונה תתבצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה וההזמנה הראשונה, ואילו יתר האספקות תבוצענה בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת כל דרישת אספקה.		נספח תנאים מיוחדים	
לא מאושר.	לעניין הדרישה לציון ניסיון באספקת הסטים נשוא המכרז, נבקש הבהרה, מאחר שאין מדובר בתנאי סף, אולם במסמכי המכרז התבקשה התייחסות לניסיון באספקת הסטים האמורים לבתי חולים אחרים, ומאחר שמדובר בסטים המותאמים באופן ייעודי לדרישותיכם, נבקש לדעת האם ניתן להתייחס במסגרת הניסיון גם לאספקת ציוד דומה ו/או מוצרים מאותה משפחת מוצרים, אשר שימשו בבתי חולים אחרים?	5	42 נספח ה עמוד 25 תשקיף משתתף
אין שינוי בנוסח הסעיף, תשומת לב המציעים כי ככל והפוליסות תתבקשנה ניתן יהיה למחוק מהן מידע עסקי סודי שלא רלוונטי.	נבקש להחליף שם את המילים "העתקי הפוליסות" במילים "אישור קיום הביטוחים".	ד'	43 נספח ח'
מקובל כי סעיף ז' ינוסח מחדש כדלקמן: "אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של החוזה. אולם אי המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים כאמור לעיל".	נבקש שעיקוב בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא יהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים מיום דרישת המרכז הרפואי בכתב.	ז'	44 נספח ח'



נספח "1"

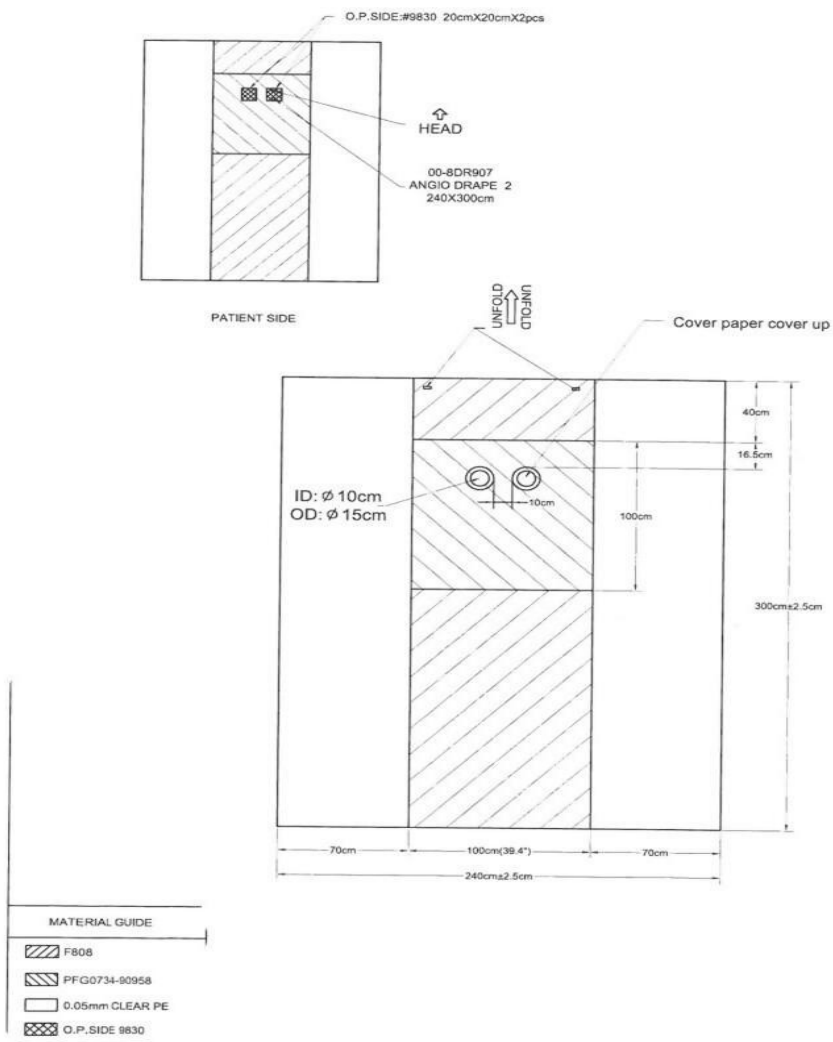



נספח "2"

BLEOMYCIN	HEPARIN
DOXYCYCLINE	LIPIDOL
ETHANOL	HEPARIN FLUSH
GLUE	GLUCOSE 5%
DMSO	FENTANYL
EMBOZONE	IKACOR
FIBROVEIN	CONTRAST
FIBROVEIN	NITROGLYCERIN
CEFAMEZINE	LIDOCAINE 1%
DORMICUM	LIDOCAINE 1%
	UROKINASE



נספח "3"

